



Données Patient	
SYLLA CHEICK AH?ED	
Date de naissance	18/01/1979
Age	45
Société	CHEC
ID	24070520034467948

Date du test: 05/07/2024 20:11:42
Durée: 4mn 00s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

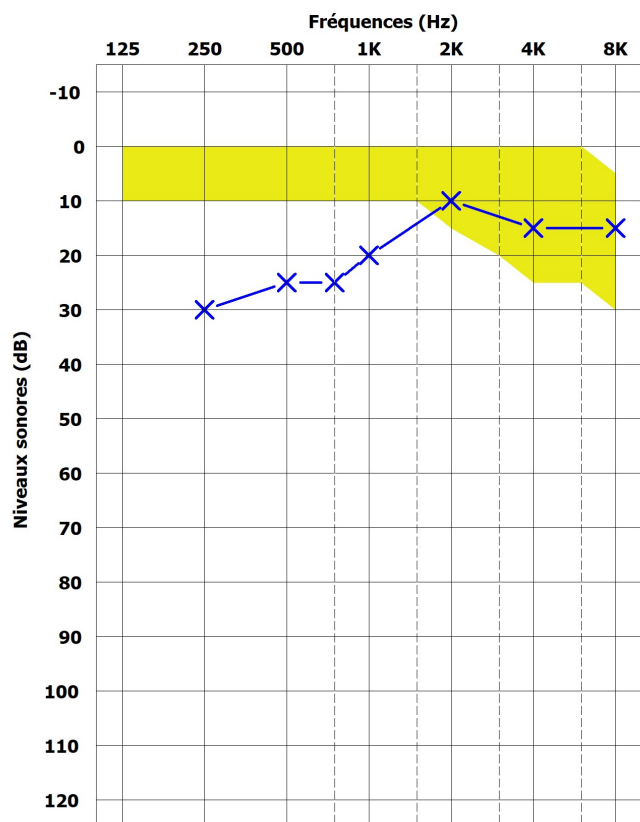

Oreille Gauche

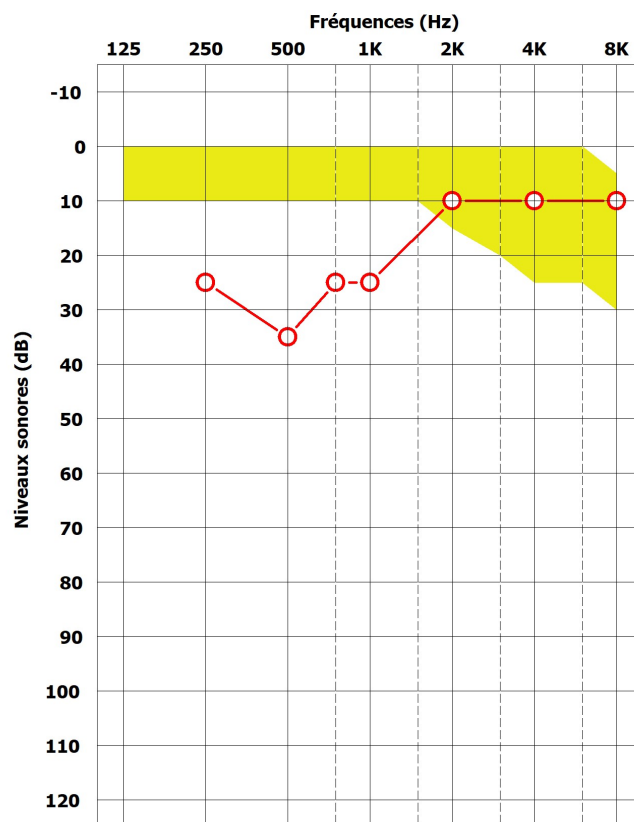

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	20		10		15		15
CA Droit		25	35	25	25		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes