

MEDVIE

Date du test: 17/07/2024 16:47:53

Durée: 4mn 12s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **BANGOURA OUSMANE**

Date de naissance 24/07/2003

Age 20

Société CHEC


ID 24071716453064424

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

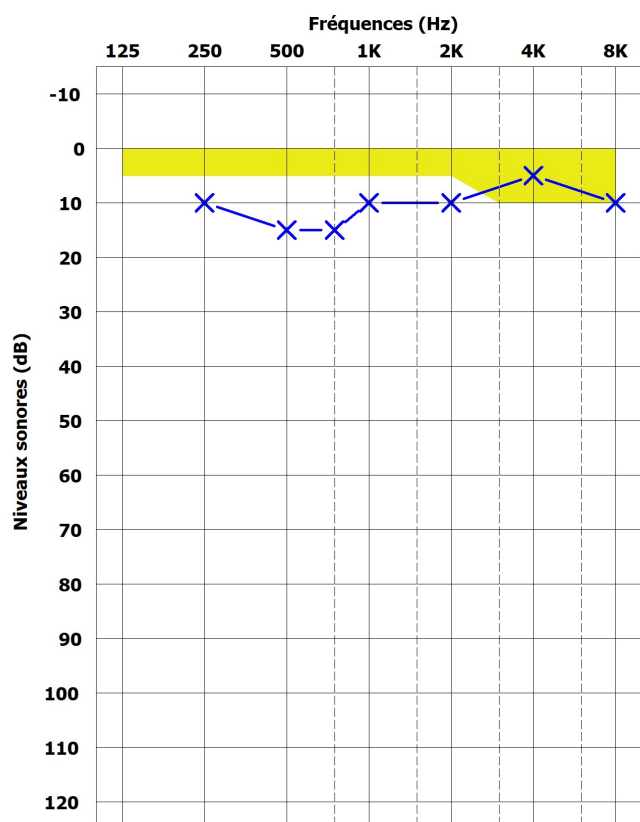

Oreille Gauche

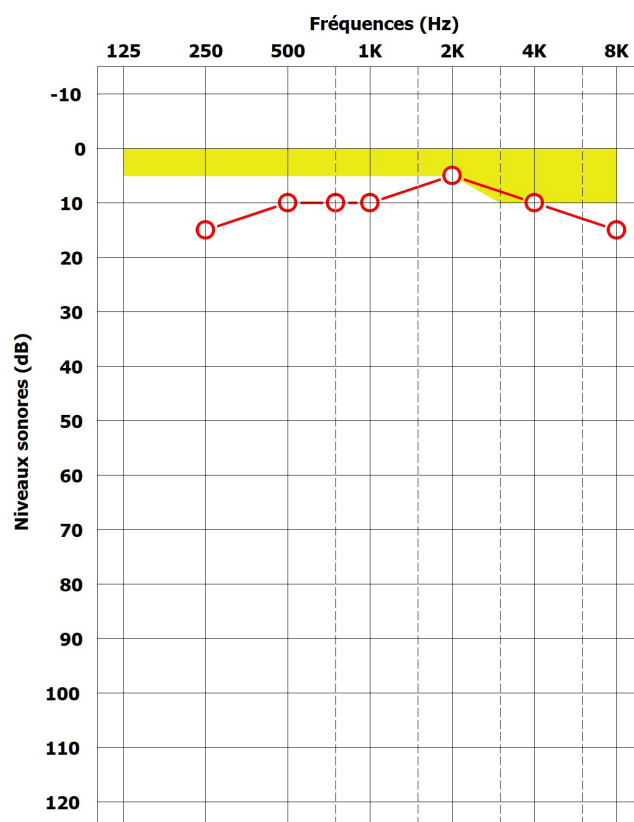

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	10		10		5		10
CA Droit		15	10	10	10		5		10		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes