

MEDVIE


Date du test: 09/08/2024 13:00:07

Durée: 5mn 16s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CHEC
ID	24080912543026164

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

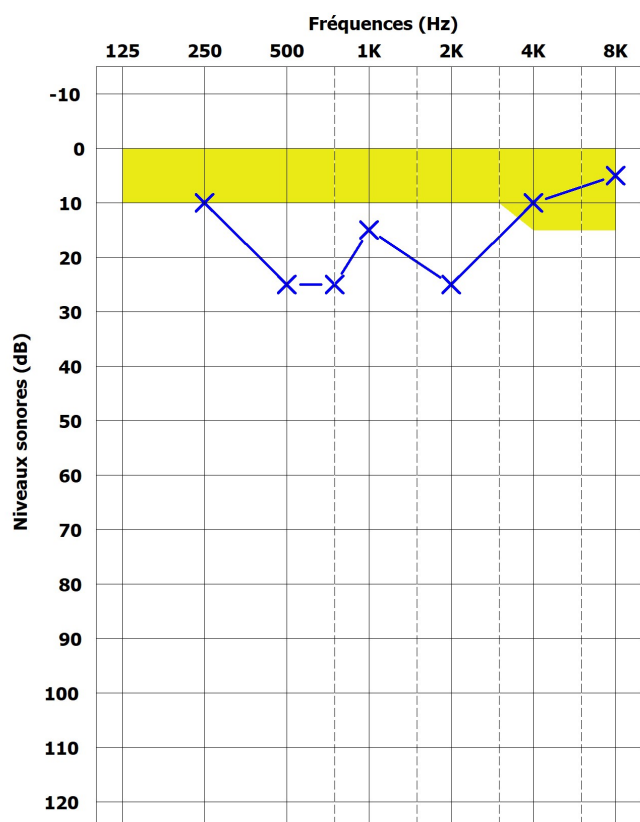

Oreille Gauche

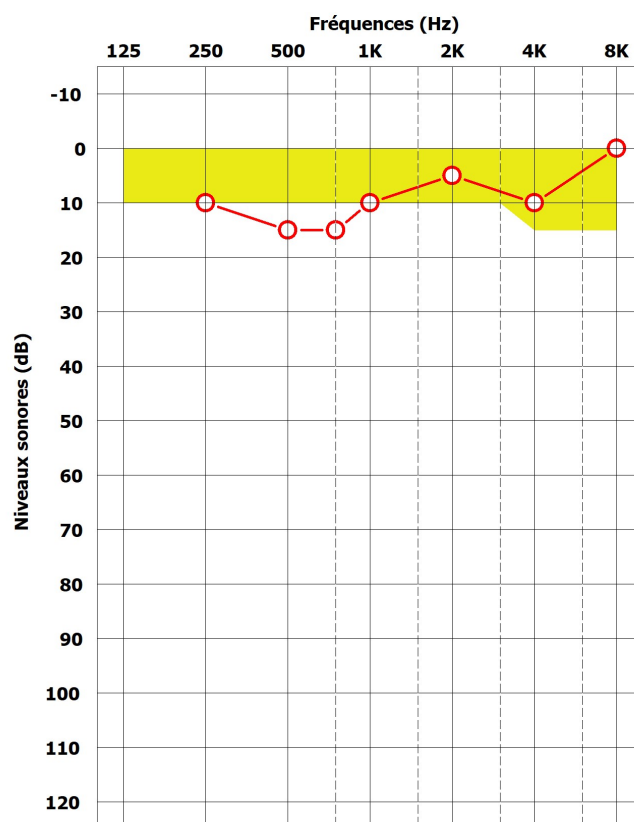

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	25	15		25		10		5
CA Droit		10	15	15	10		5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes