

MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 13:22:19

Durée: 4mn 50s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA ALYA	
Date de naissance	10/04/1990
Age	34
Société	CHEC
ID	24080713165219742

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

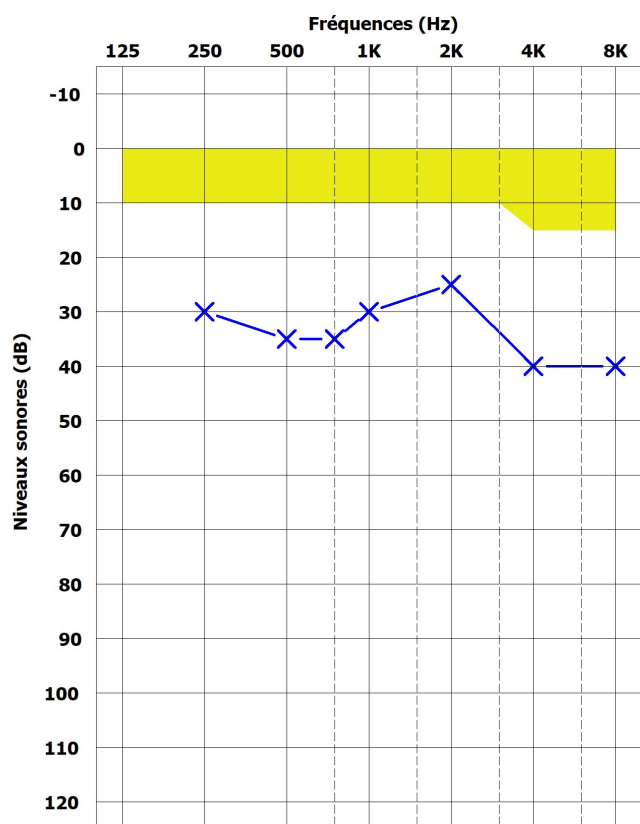

Oreille Gauche

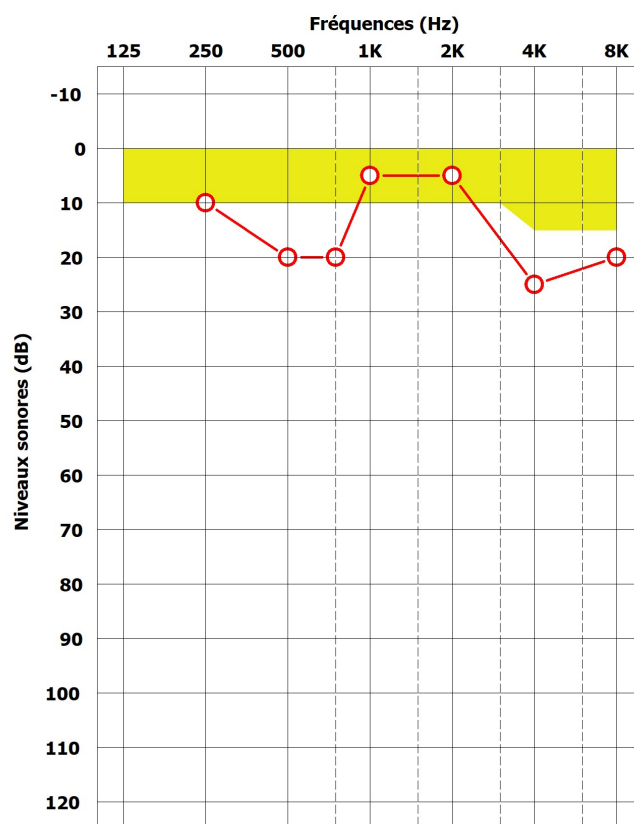

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	35	30		25		40		40
CA Droit		10	20	20	5		5		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	32,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes