


MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 15:34:19
Durée: 2mn 11s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
BANGOURA MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CHEC
ID	24080715252065578

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

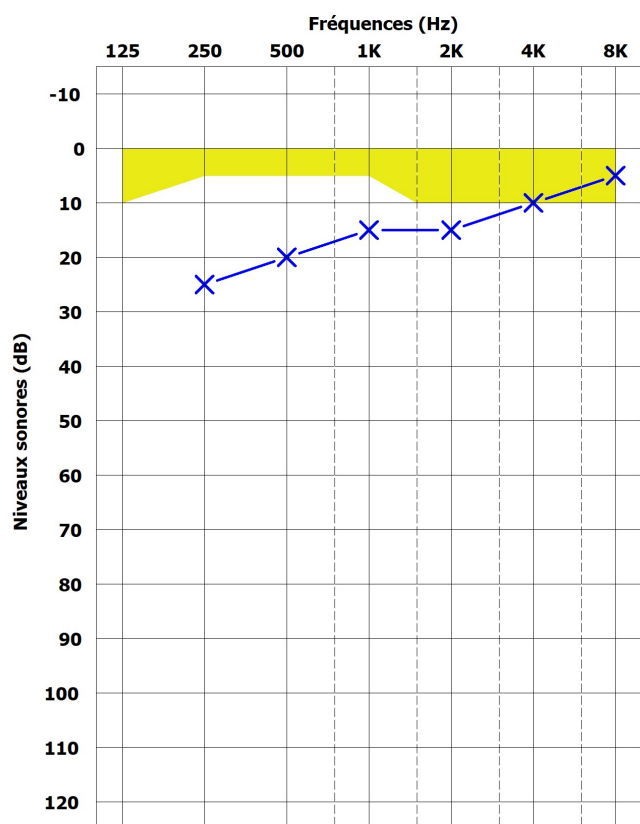

Oreille Gauche

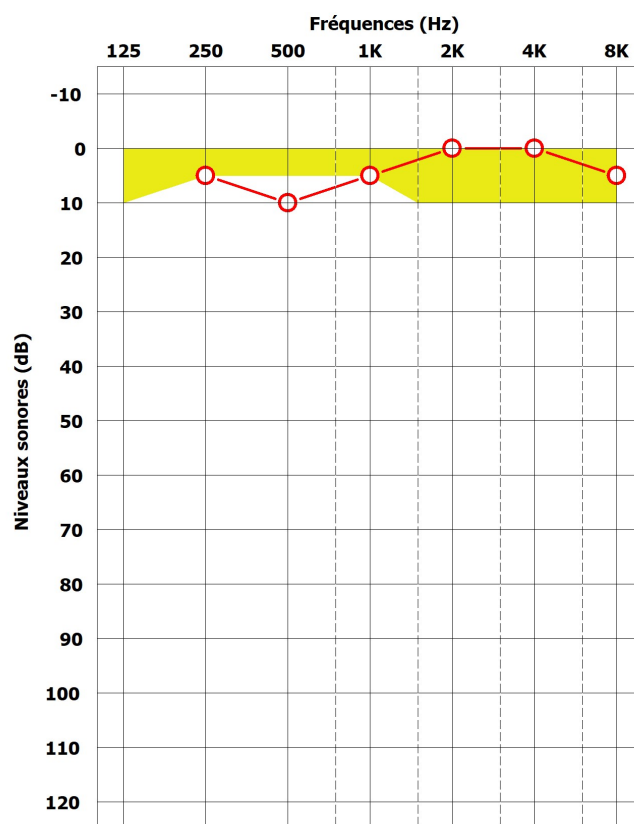

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20		15		15		10		5
CA Droit		5	10		5		0		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes