



Données Patient	SANDOUNO HERVE MATHIAS
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CHEC
ID	24083115180748118

Date du test: 31/08/2024 15:23:55
Durée: 4mn 52s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

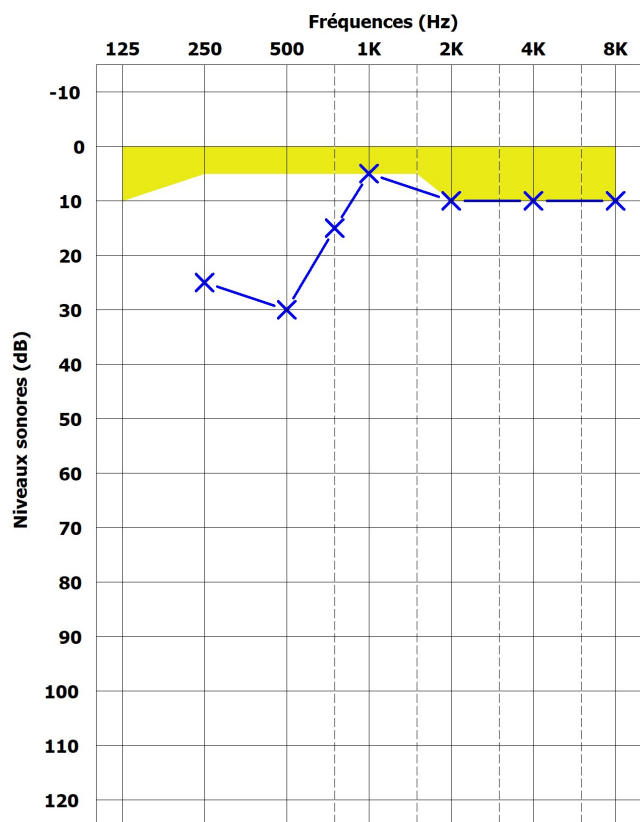

Oreille Gauche

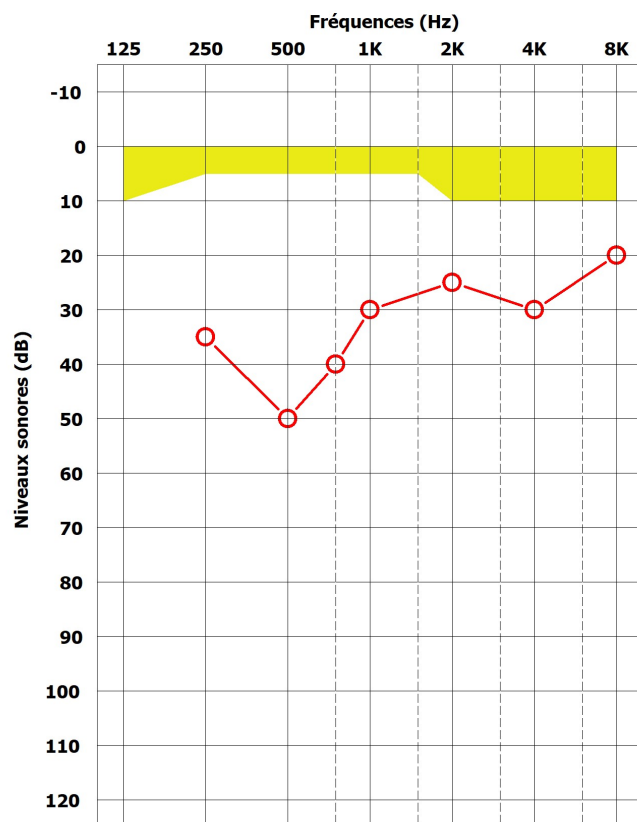

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	15	5		10		10		10
CA Droit		35	50	40	30		25		30		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	33,8 dB	---

Notes