



Données Patient


CAMARA MOHAMED

Date de naissance 27/08/1985
Age 39
Société CHEC
ID 24091411183648512


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 14/09/2024 11:31:20
Durée: 4mn 04s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

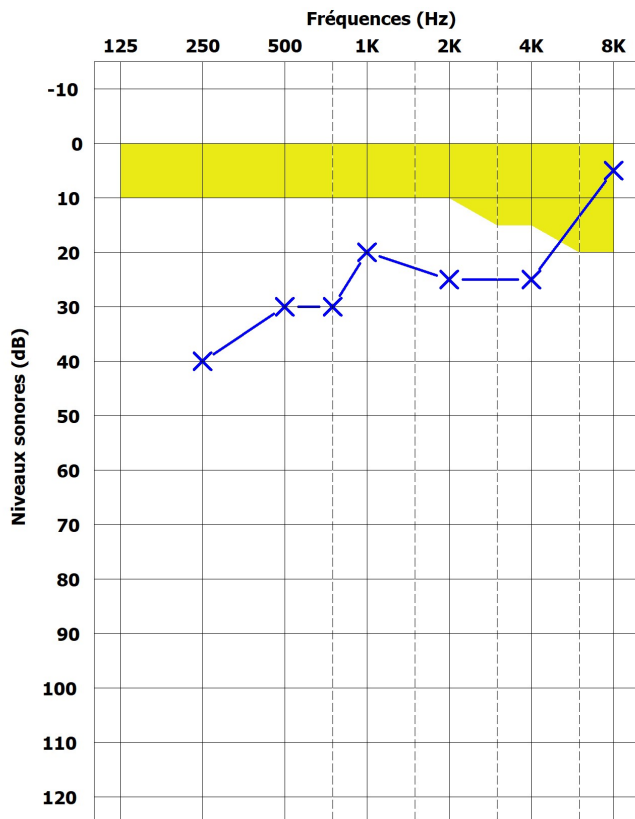

Oreille Gauche

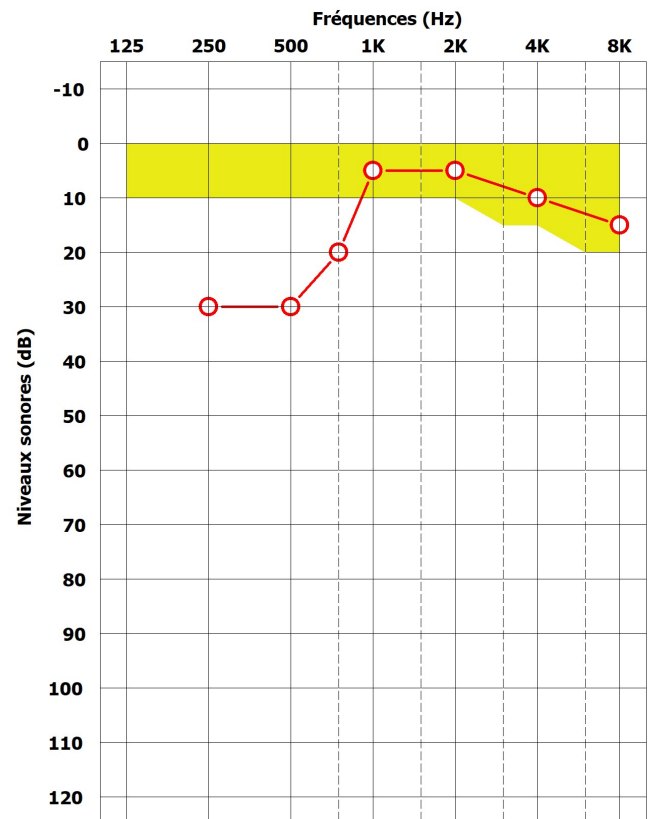

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	30	30	20		25		25		5
CA Droit		30	30	20	5		5		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes