


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 18:29:31
Durée: 2mn 54s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
BANGOURA ISMAEL	
Date de naissance	16/06/1985
Age	39
Société	CHEC
ID	24081418272957533

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

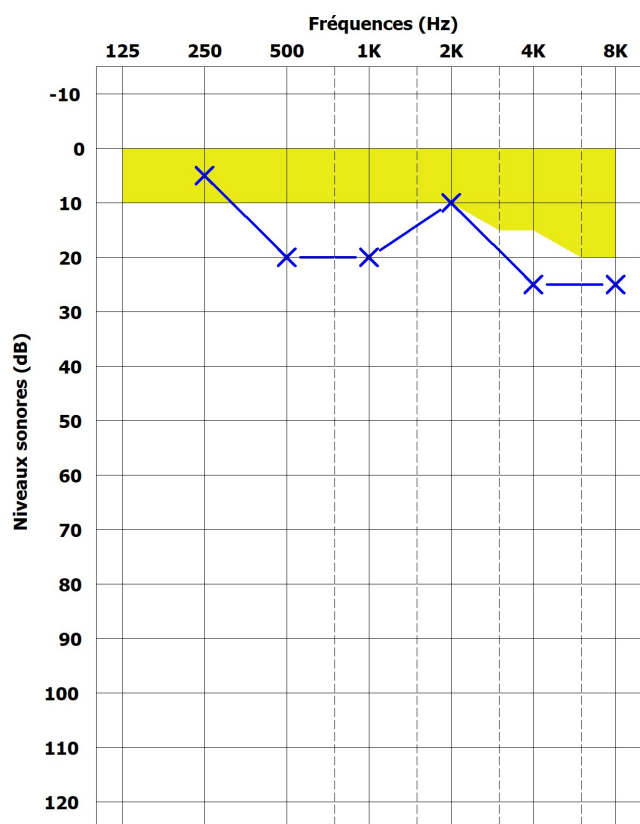

Oreille Gauche

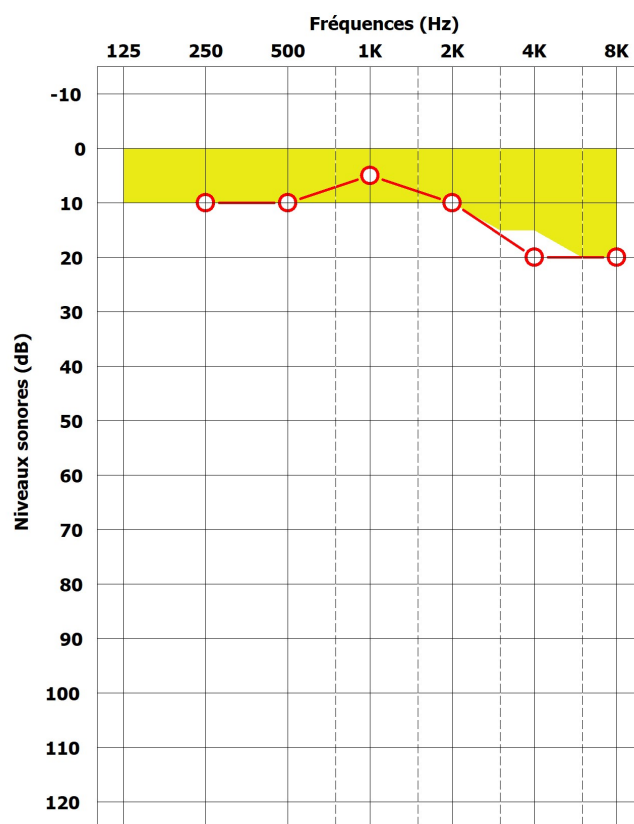

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	20		20		10		25		25
CA Droit		10	10		5		10		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes