



Données Patient	
BANGOURA MOHAMED M'MATA	
Date de naissance	03/11/2003
Age	20
Société	CHEC
ID	24092614474740963

Date du test: 26/09/2024 14:50:06
Durée: 4mn 24s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

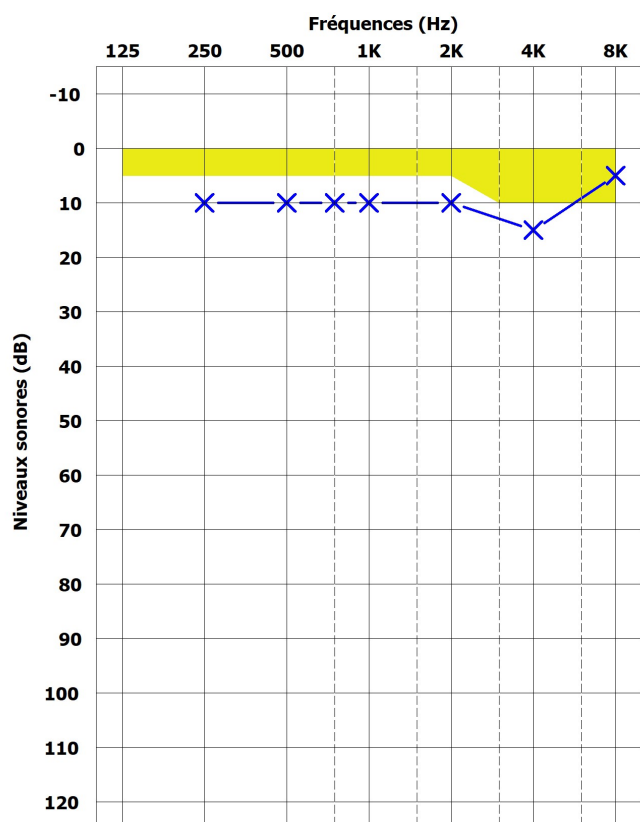

Oreille Gauche

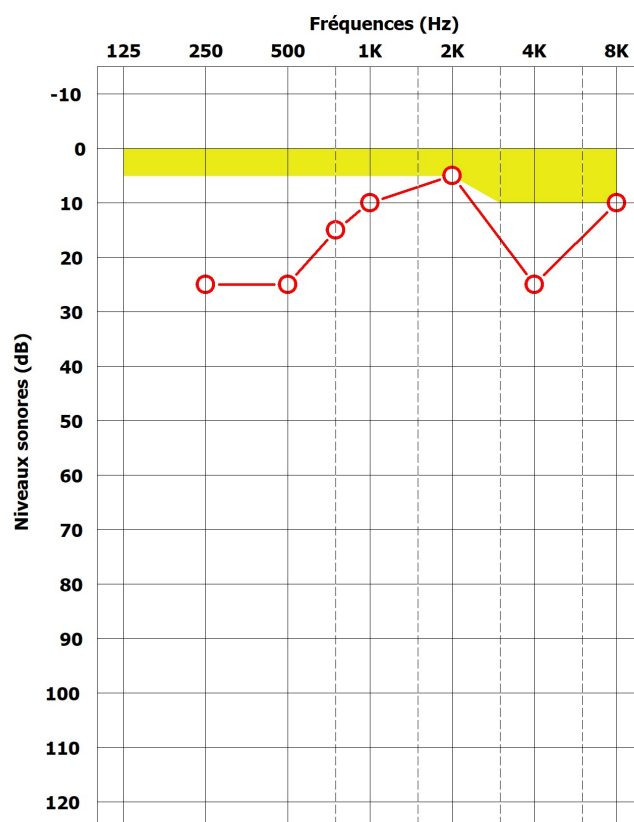

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	10		10		15		5
CA Droit		25	25	15	10		5		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes