

Données Patient


CAMARA M'BEMBA

Date de naissance 02/01/1995
Age 29
Société CHEC
ID 24092615284147773


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 26/09/2024 15:30:03
Durée: 3mn 16s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

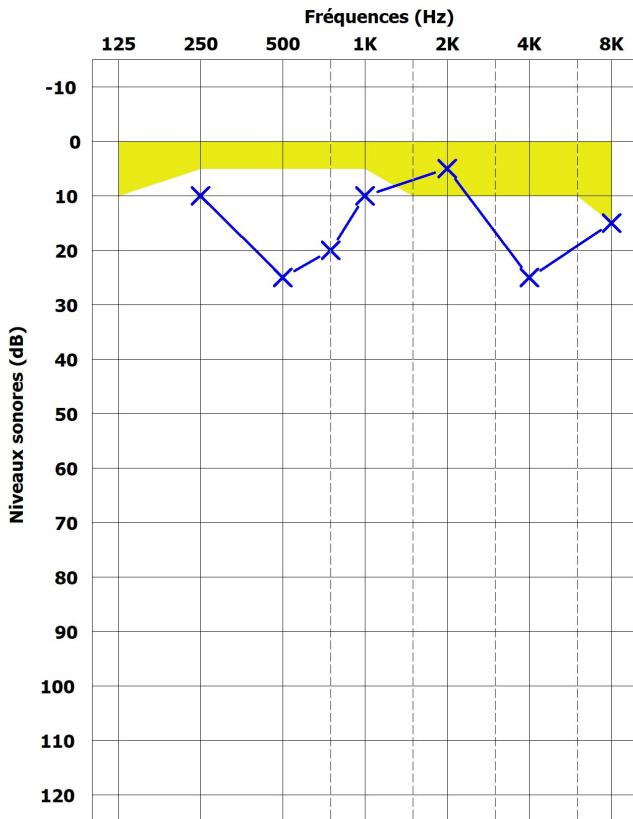

Oreille Gauche

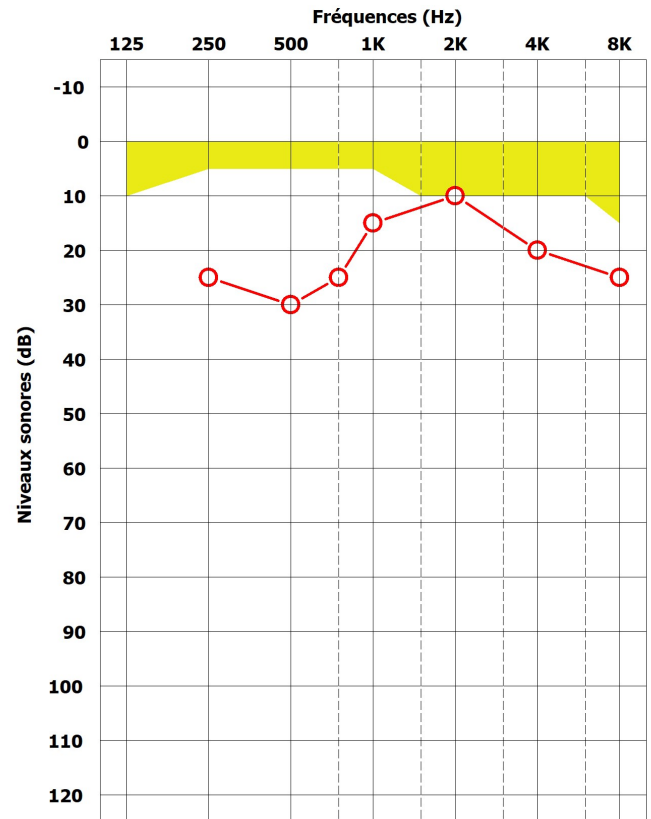

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	20	10		5		25		15
CA Droit		25	30	25	15		10		20		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes