



Données Patient


SYLLA ALIA

Date de naissance 01/01/1999
Age 25
Société CHEC
ID 24070519262146919


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 05/07/2024 19:28:34
Durée: 3mn 07s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

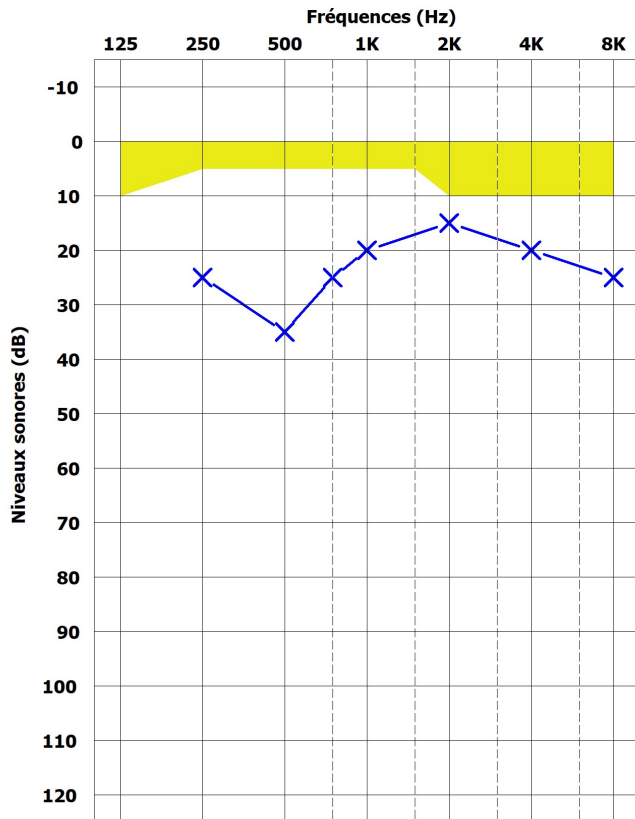

Oreille Gauche

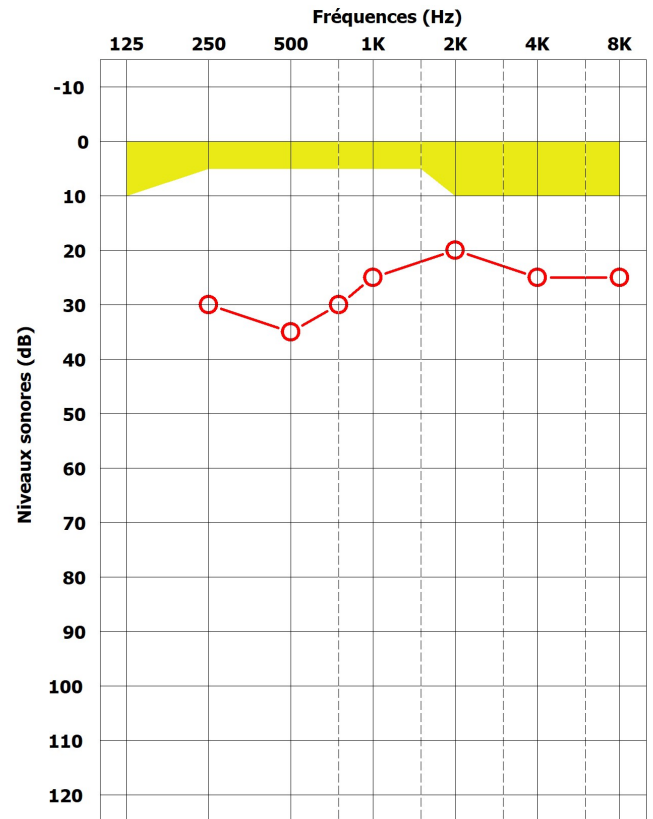

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	25	20		15		20		25
CA Droit		30	35	30	25		20		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes