



Données Patient


SOUMAH IBRAHIMA

Date de naissance 01/01/1980
Age 44
Société CHEC
ID 24092613341529958


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 26/09/2024 13:37:07
Durée: 4mn 34s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

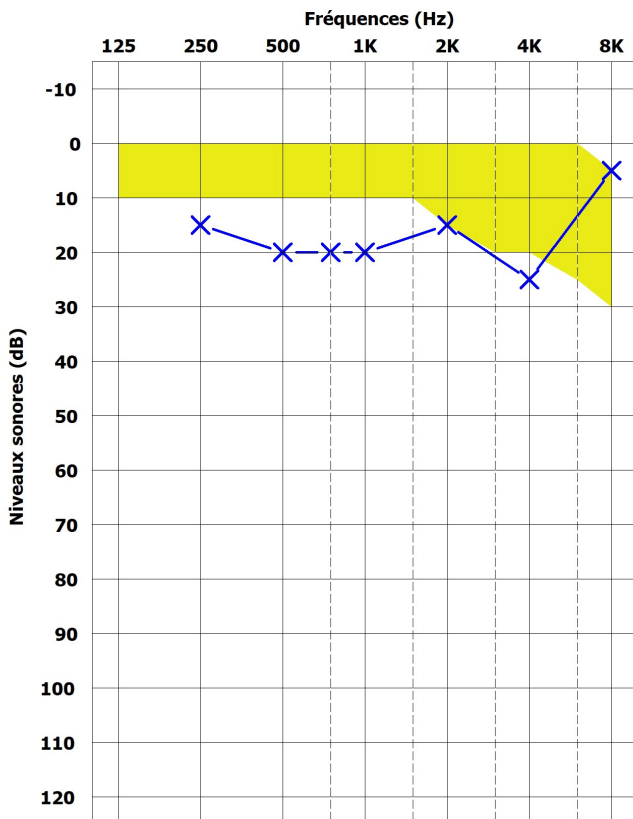

Oreille Gauche

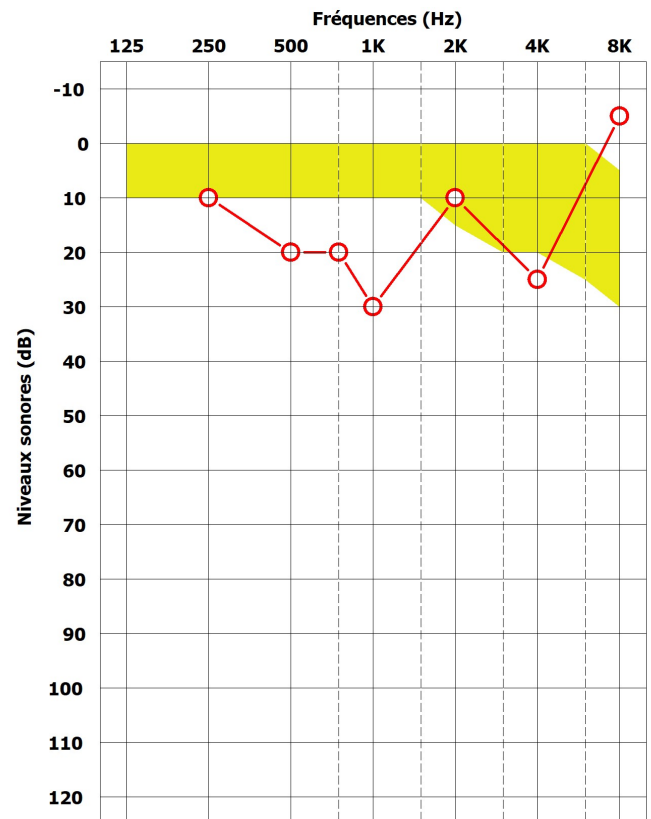

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	20	20		15		25		5
CA Droit		10	20	20	30		10		25		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes