



Données Patient	
SOUMAH MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1987
Age	37
Société	CHEC
ID	24092614400866863

Date du test: 26/09/2024 14:41:40
Durée: 5mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

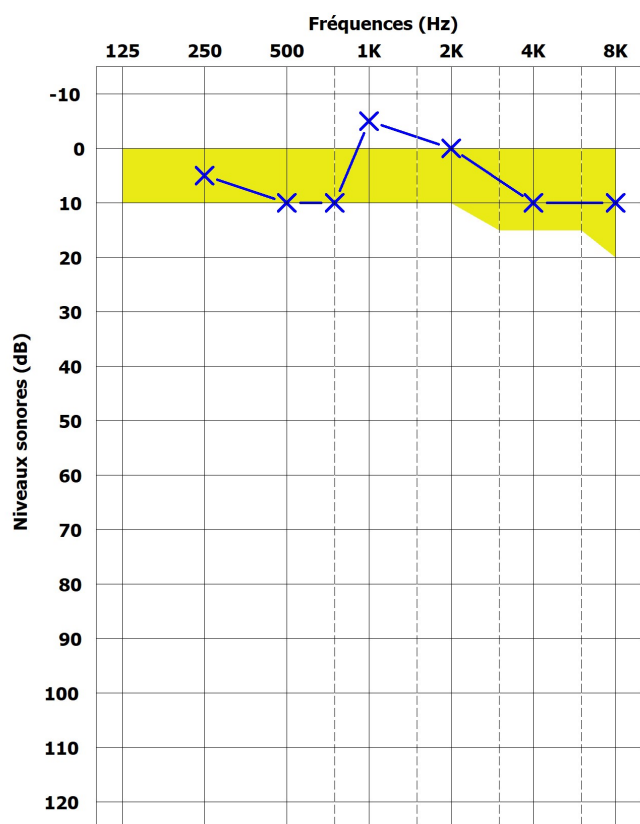

Oreille Gauche

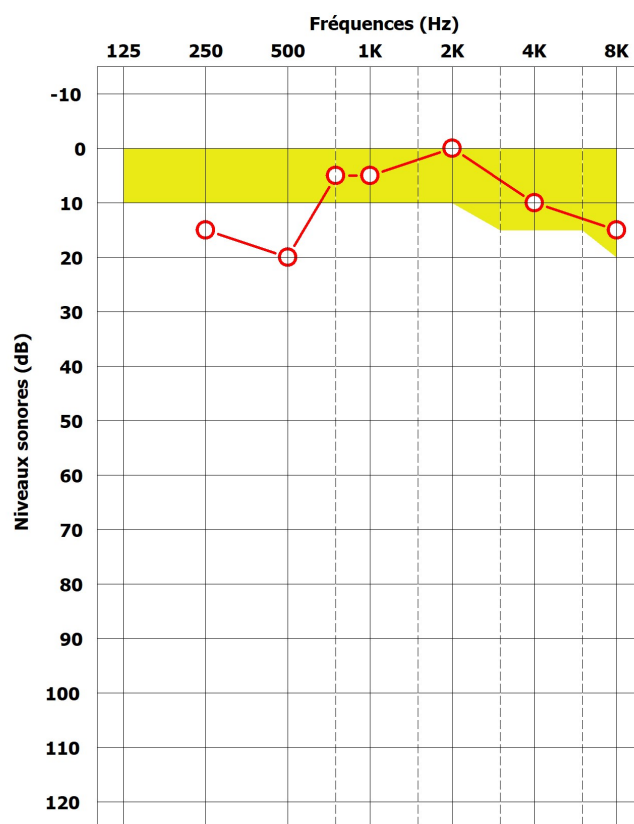

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	-5		0		10		10
CA Droit		15	20	5	5		0		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes