

MEDVIE


Date du test: 06/09/2024 14:21:28

Durée: 3mn 27s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BANGOURA MOHAMED
Date de naissance	01/07/1986
Age	38
Société	CHEC
ID	24090614142766636

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

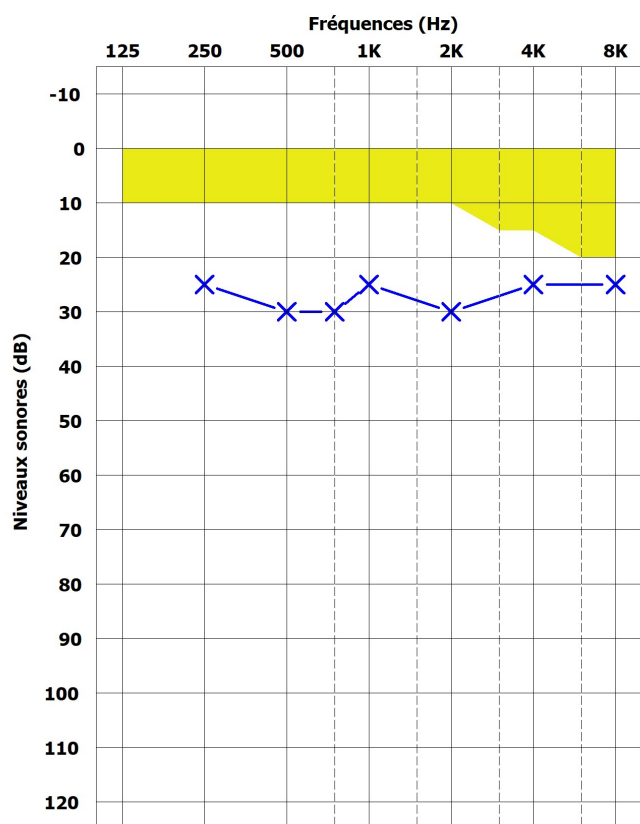

Oreille Gauche

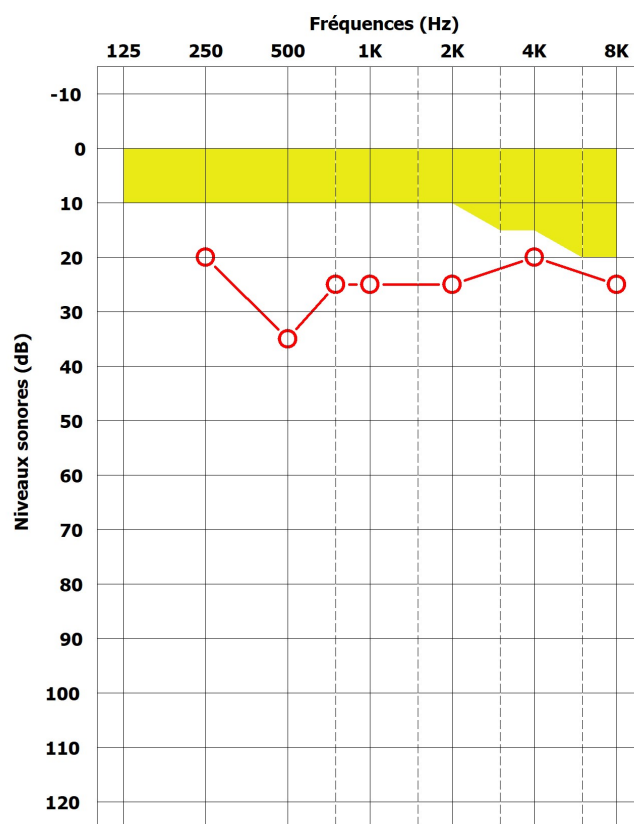

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	30	25		30		25		25
CA Droit		20	35	25	25		25		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes