

MEDVIE


Date du test: 15/08/2024 17:12:45

Durée: 5mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BANGOURA DAOUDA
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CHEC
ID	24081517113972019

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

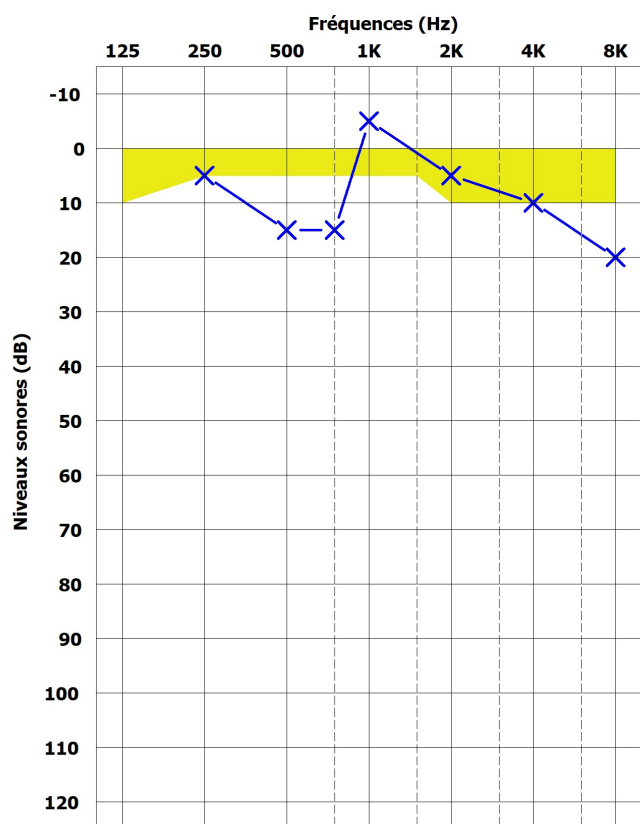

Oreille Gauche

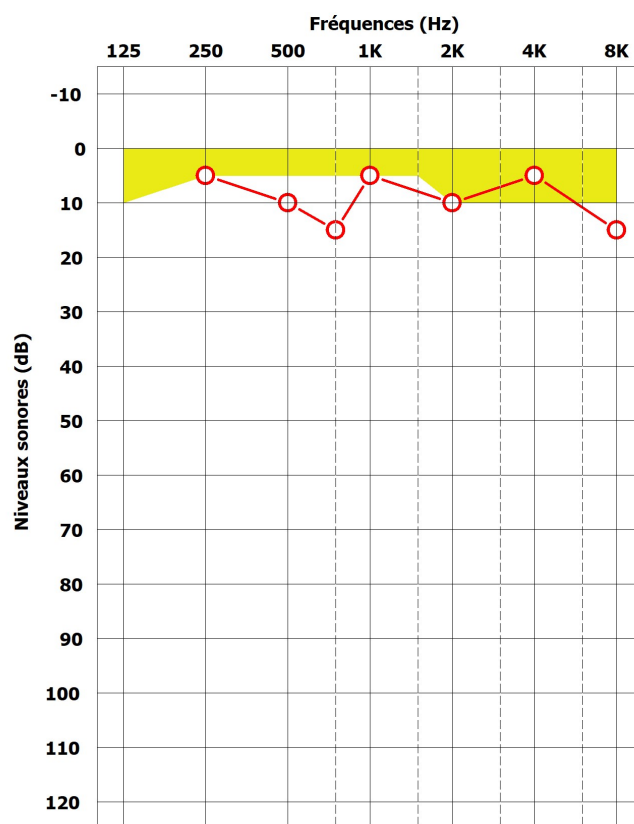

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	15	-5		5		10		20
CA Droit		5	10	15	5		10		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes