


MEDVIE


Date du test: 15/08/2024 16:27:04
Durée: 2mn 25s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
SAKOUVOGUI FOROMO	
Date de naissance	10/09/1989
Age	34
Société	CHEC
ID	24081516212207089

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

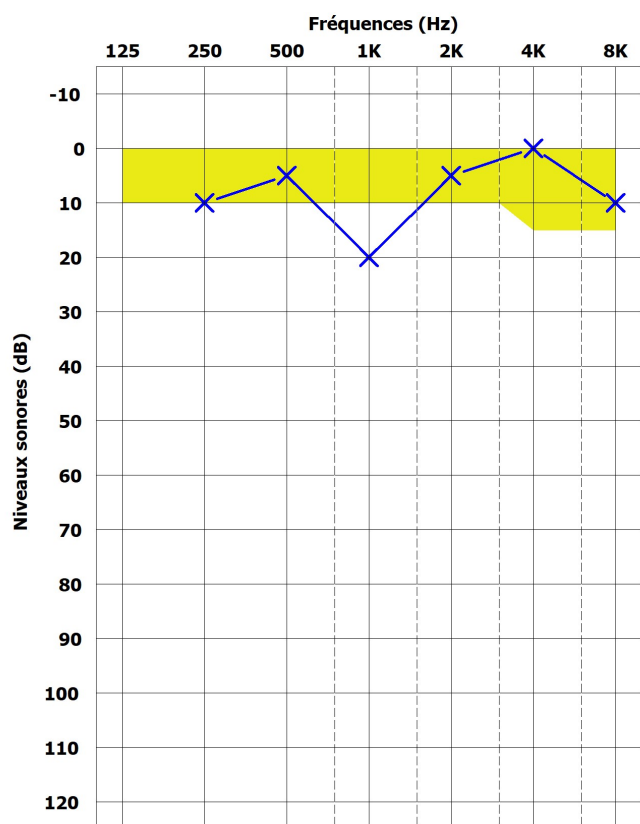

Oreille Gauche

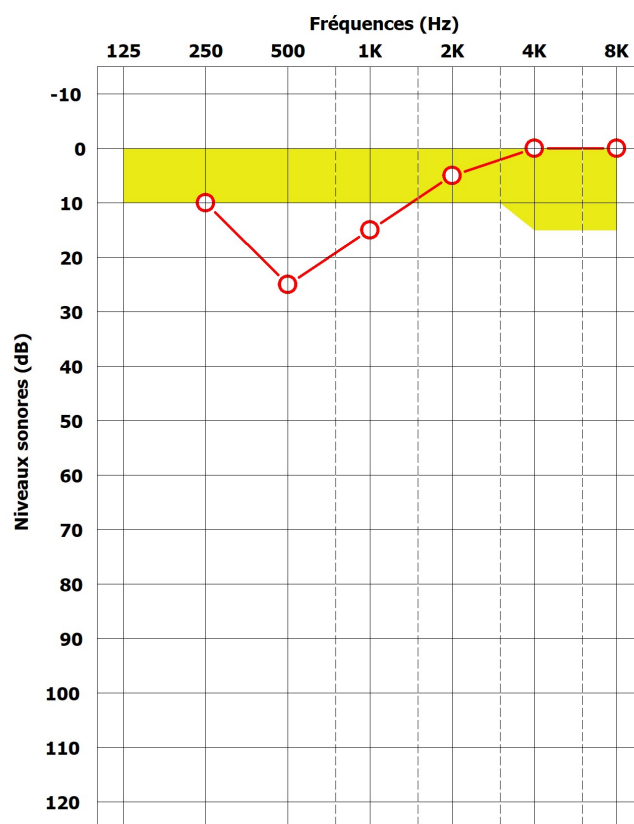

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5		20		5		0		10
CA Droit		10	25		15		5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes