
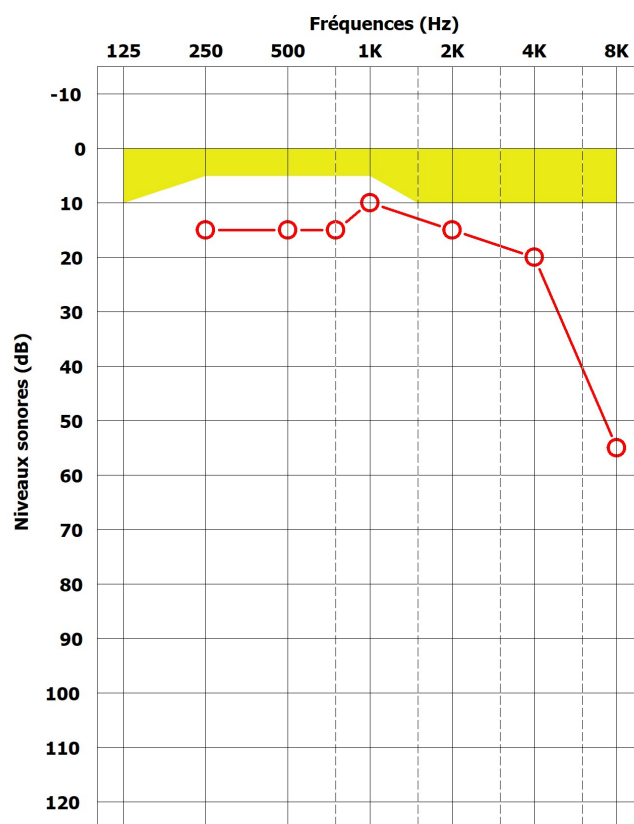


Données Patient	
SOUMAH M'BEMBA	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CHEC
ID	24092516550935100

Date du test: 25/09/2024 16:56:44
Durée: 4mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

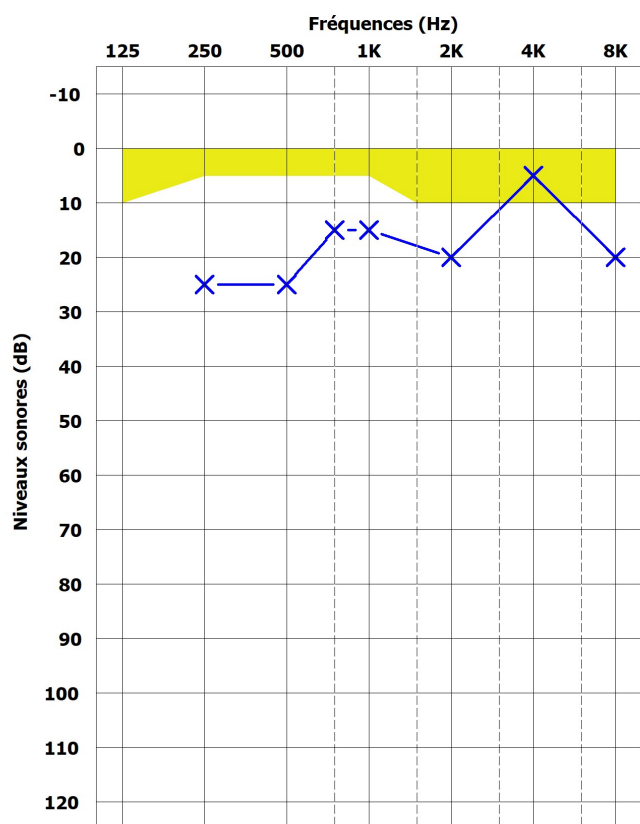

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	15		20		5		20
CA Droit		15	15	15	10		15		20		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes