


MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 11:58:14
Durée: 5mn 23s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAGNO MATHIEU	
Date de naissance	06/06/1998
Age	26
Société	CHEC
ID	24080711410000400

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

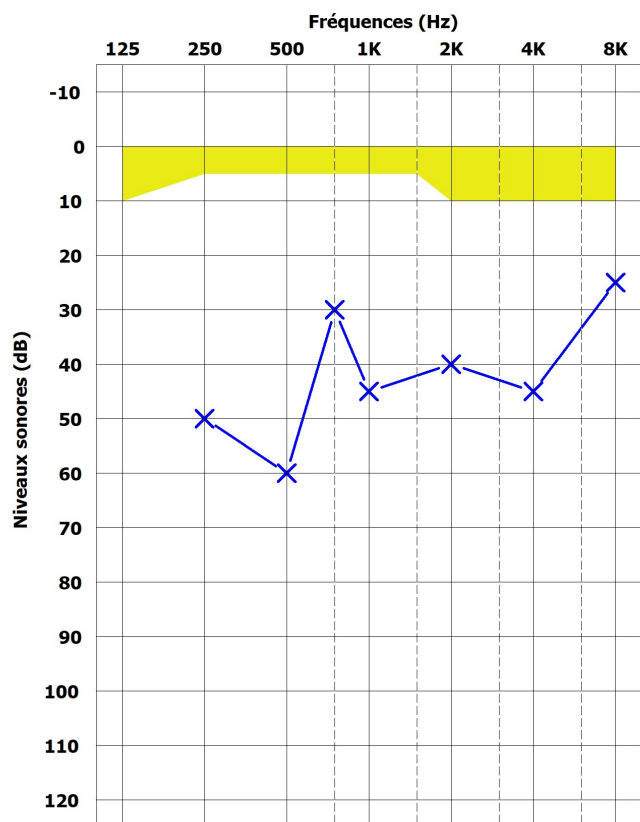

Oreille Gauche

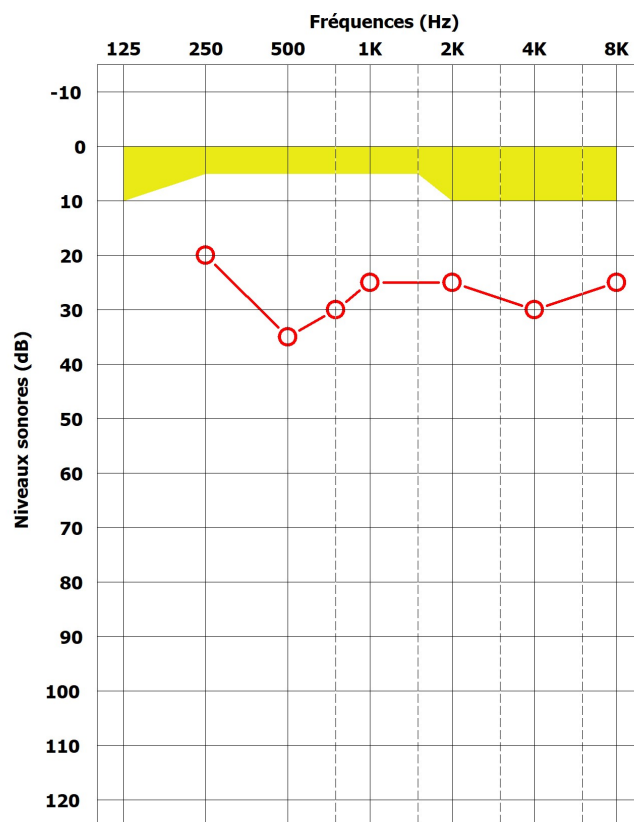

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		50	60	30	45		40		45		25
CA Droit		20	35	30	25		25		30		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	47,5 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes