



| Données Patient   |  | BAKRY MAMADOU ALPHA |
|-------------------|--|---------------------|
| Date de naissance |  | 01/01/1993          |
| Age               |  | 31                  |
| Société           |  | CHEC                |
| ID                |  | 24112411271263868   |

Date du test: 24/11/2024 11:28:38  
Durée: 5mn 14s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

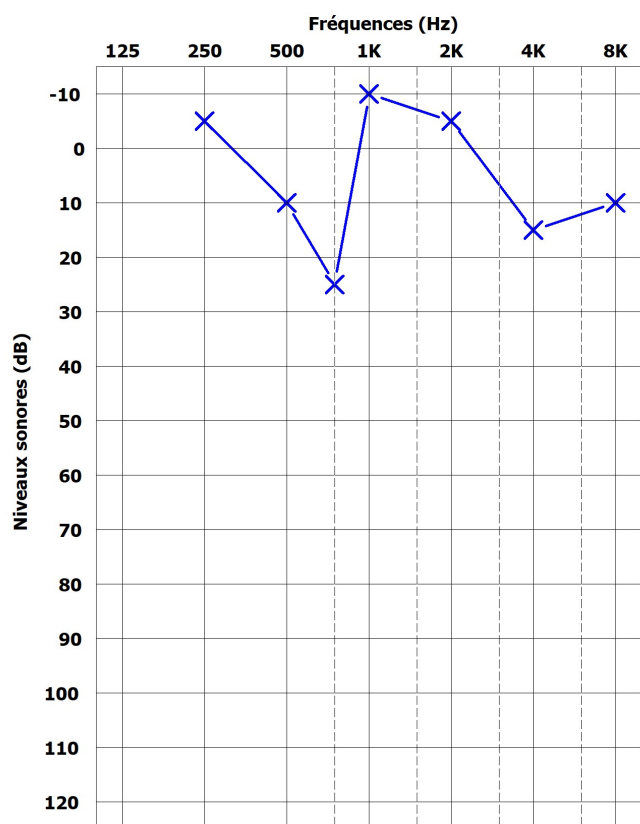

Oreille Gauche

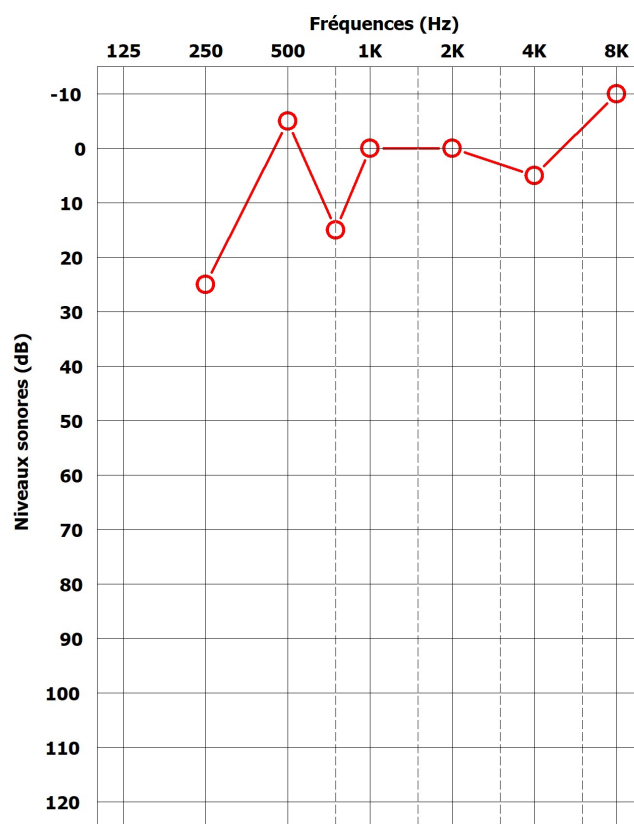

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k  | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|
| CA Gauche |     | -5  | 10  | 25  | -10 |     | -5 |    | 15 |    | 10  |
| CA Droit  |     | 25  | -5  | 15  | 0   |     | 0  |    | 5  |    | -10 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 2,5 dB | --- |
| CA Droit        | 0,0 dB | --- |

Notes