



Données Patient	
BANGOURA FATOUMATA YARIF	
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CHEC
ID	24092518443970129

Date du test: 25/09/2024 18:46:07
Durée: 3mn 47s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

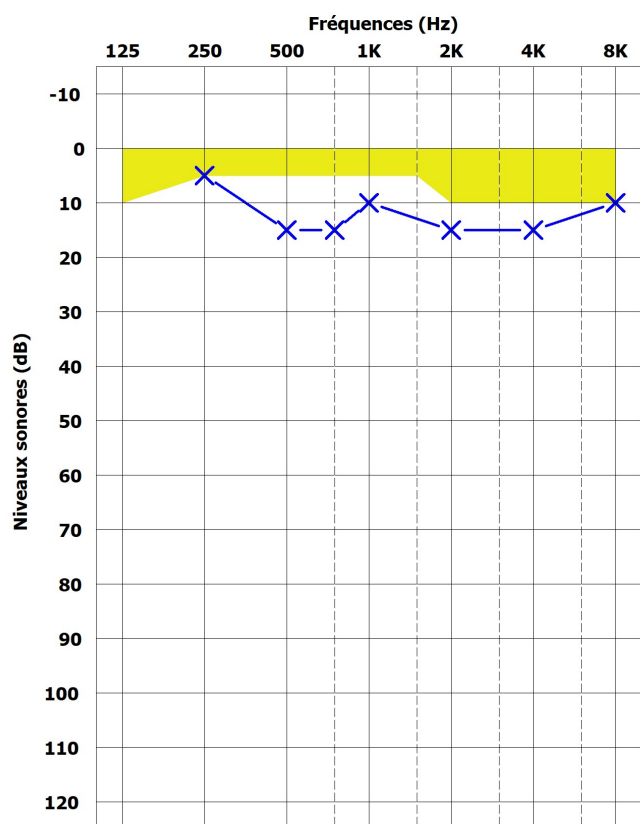

Oreille Gauche

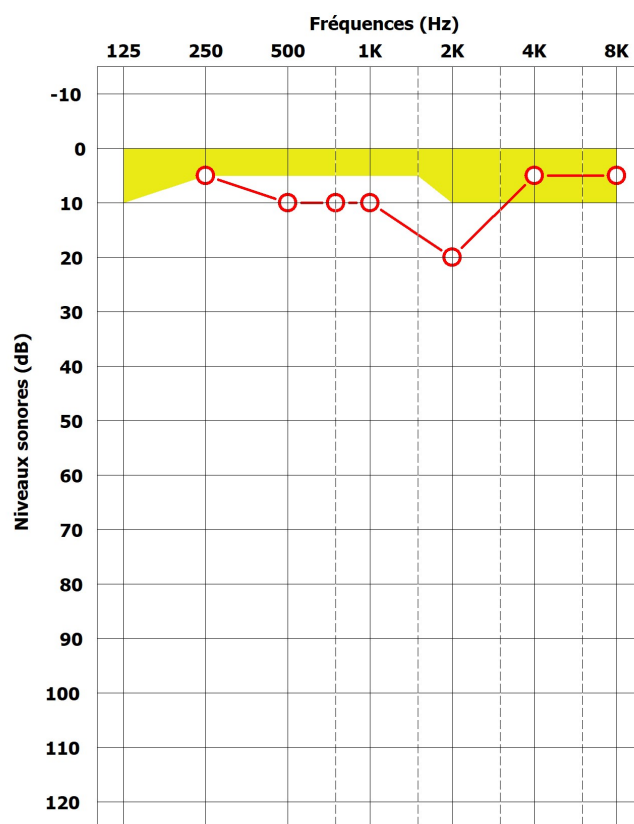

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	15	10		15		15		10
CA Droit		5	10	10	10		20		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes