


MEDVIE


Date du test: 06/09/2024 14:32:33
Durée: 3mn 17s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BANGOURA MAMADY
Date de naissance	01/01/1987
Age	37
Société	CHEC
ID	24090614273467142

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

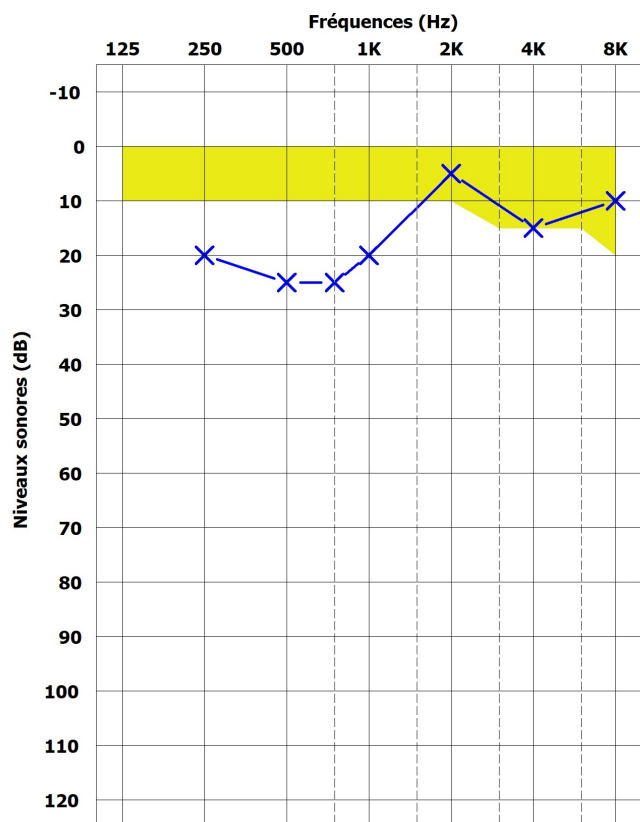

Oreille Gauche

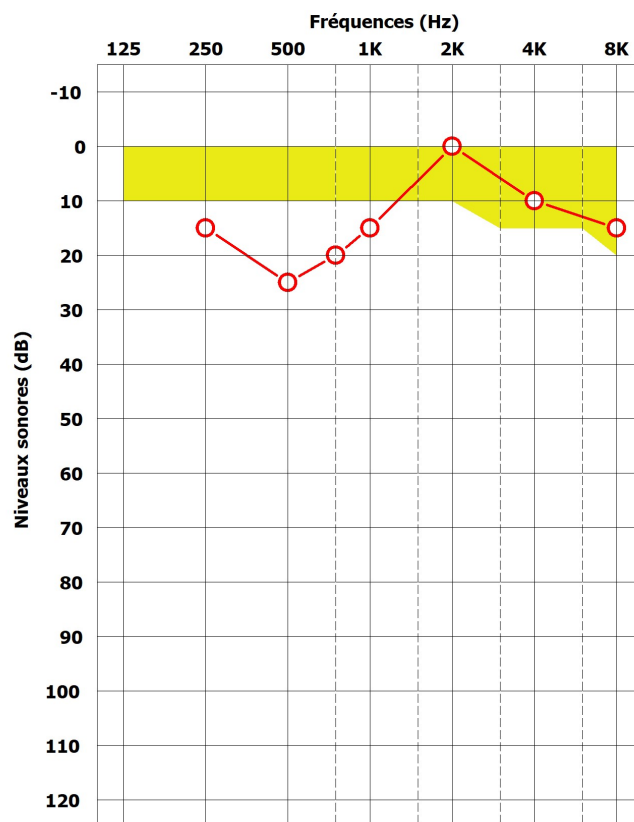

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	20		5		15		10
CA Droit		15	25	20	15		0		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes