


Données Patient	
SOW Oumar BAILLO	
Date de naissance	06/08/1994
Age	29
Société	CHEC
ID	24072515151060067


MED VIE

Date du test: 25/07/2024 15:25:32
Durée: 1mn 34s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

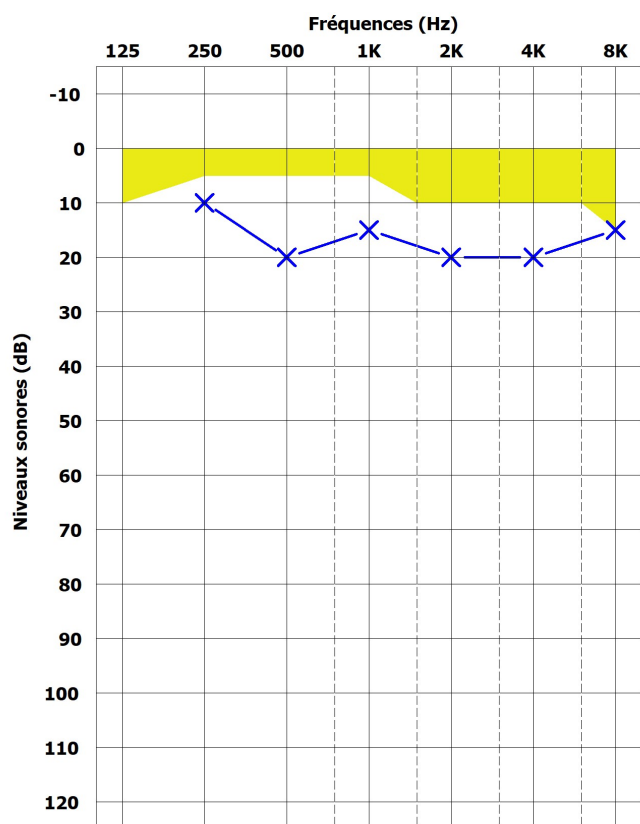

Oreille Gauche

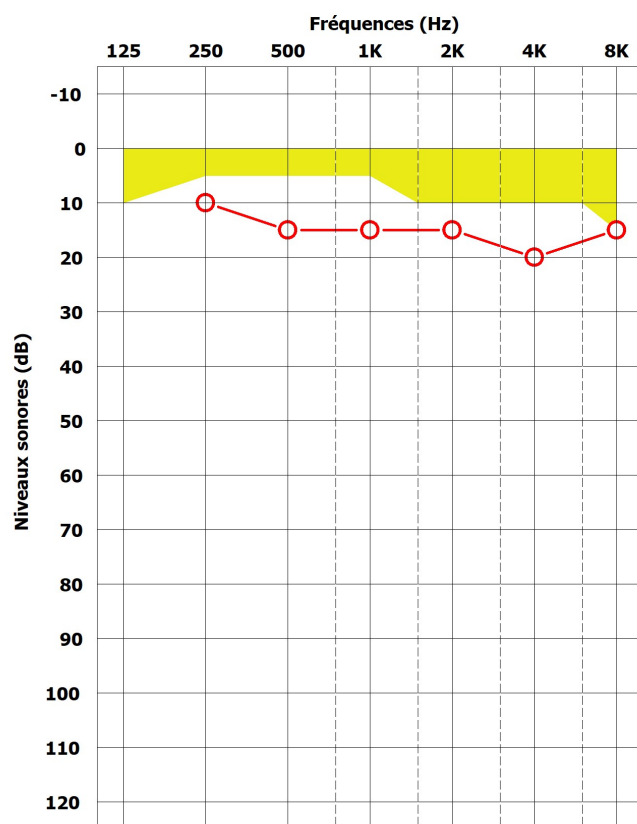

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20		15		20		20		15
CA Droit		10	15		15		15		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes