



Données Patient


BANGOURA ABDOULAYE

Date de naissance 01/01/1994
Age 30
Société CHEC
ID 24090612171465806


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 06/09/2024 12:24:24
Durée: 5mn 26s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

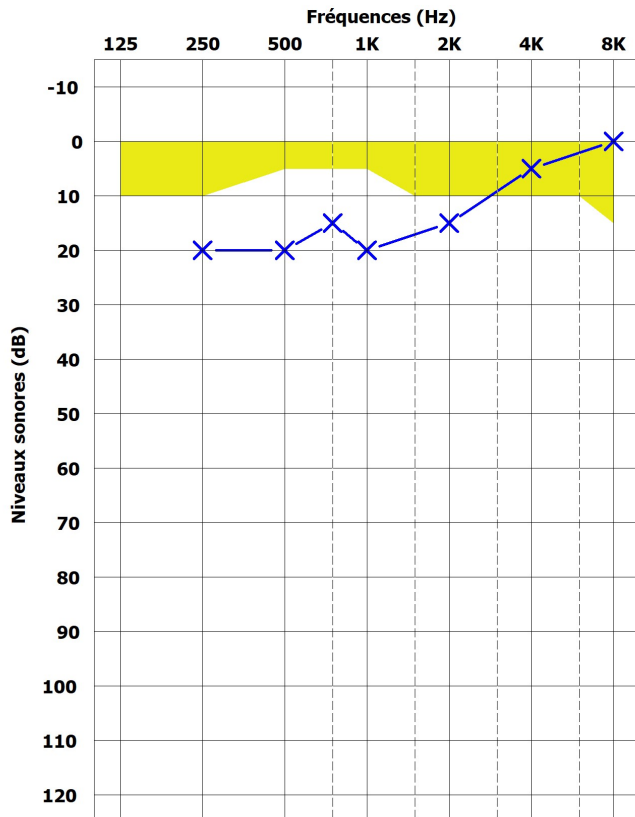

Oreille Gauche

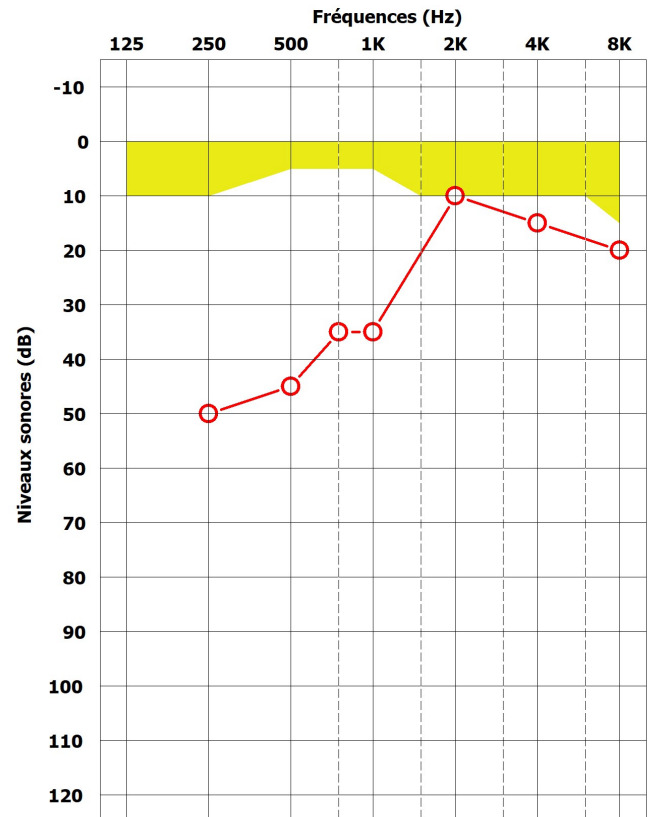

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	15	20		15		5		0
CA Droit		50	45	35	35		10		15		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes