


MEDVIE


Date du test: 15/08/2024 17:07:28
Durée: 3mn 20s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
SOUMAH MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CHEC
ID	24081516565301587

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

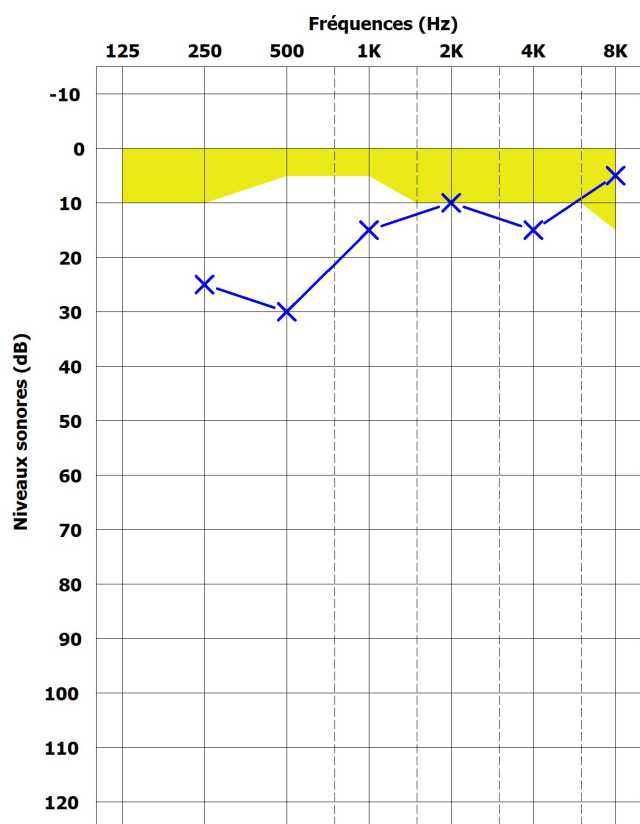

Oreille Gauche

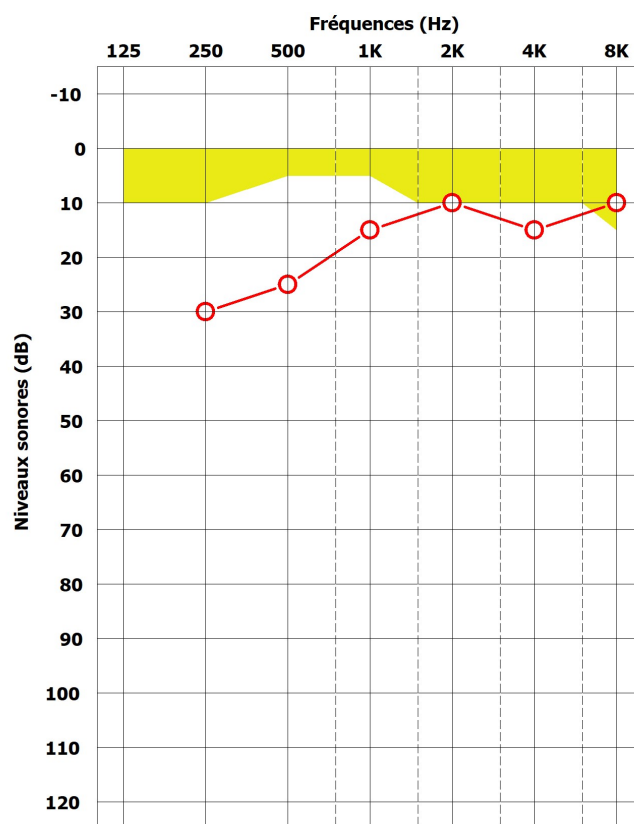

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30		15		10		15		5
CA Droit		30	25		15		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes