



| Données Patient   |                   | TRAORE YAMOUSSA |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Date de naissance | 12/12/2000        |                 |
| Age               | 23                |                 |
| Société           | CHEC              |                 |
| ID                | 24092614000855053 |                 |

Date du test: 26/09/2024 14:01:54  
 Durée: 4mn 09s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

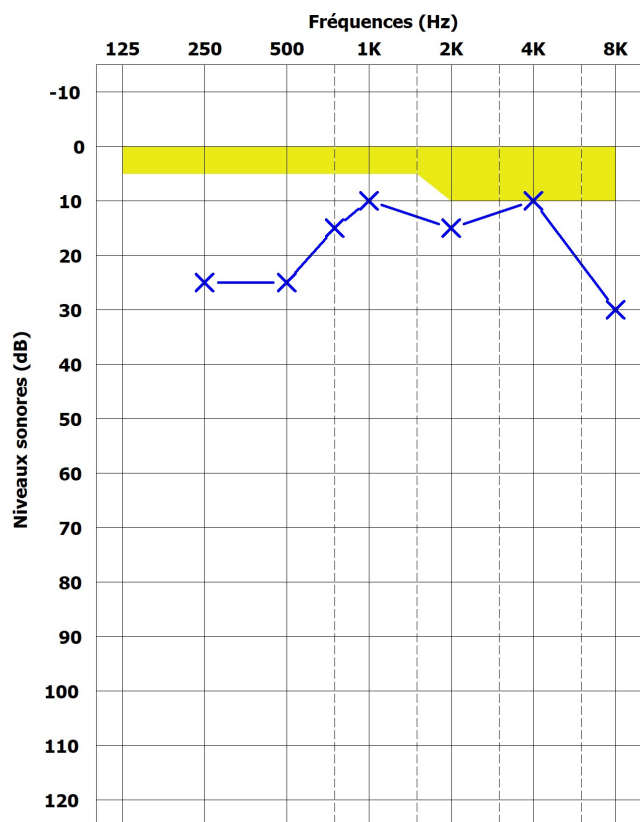

Oreille Gauche

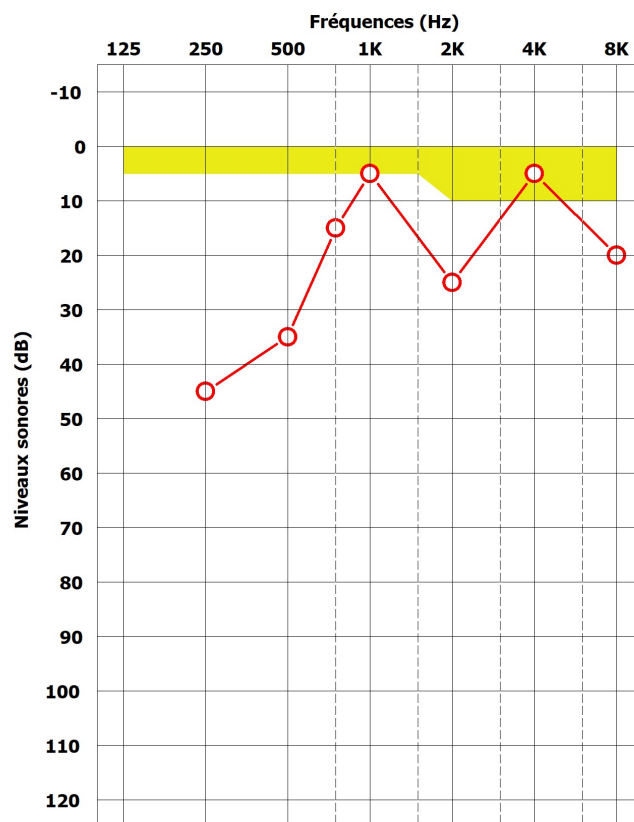

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 25  | 15  | 10 |     | 15 |    | 10 |    | 30 |
| CA Droit  |     | 45  | 35  | 15  | 5  |     | 25 |    | 5  |    | 20 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 15,0 dB | --- |
| CA Droit        | 17,5 dB | --- |

Notes