


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 12:53:25
Durée: 3mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SYLLA AMARA	
Date de naissance	15/10/1987
Age	36
Société	CHEC
ID	24091412492131365

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

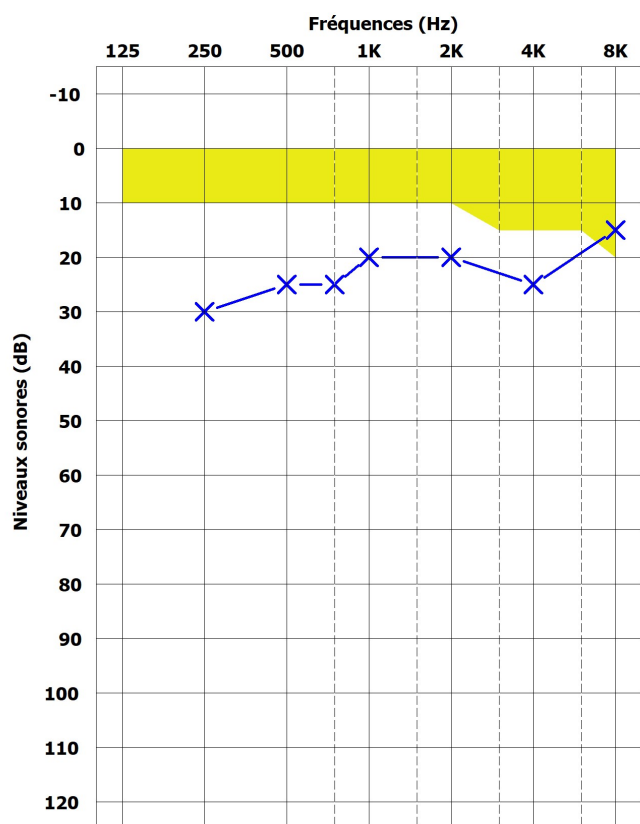

Oreille Gauche

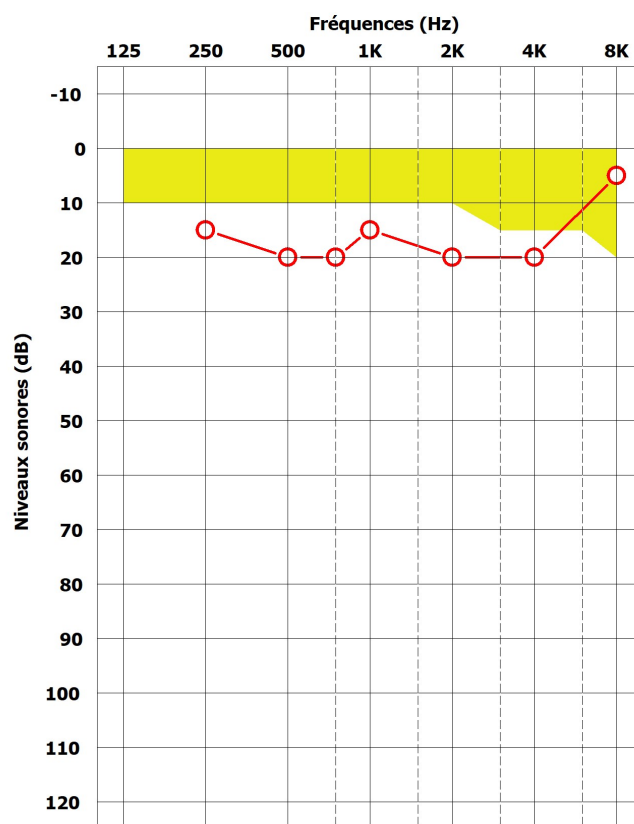

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	20		20		25		15
CA Droit		15	20	20	15		20		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes