



| Données Patient         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| BANGOURA AMARA<br>SAYON |                   |
| Date de naissance       | 01/01/1992        |
| Age                     | 32                |
| Société                 | CHEC              |
| ID                      | 24092617064597725 |

Date du test: 26/09/2024 17:08:36  
Durée: 5mn 34s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

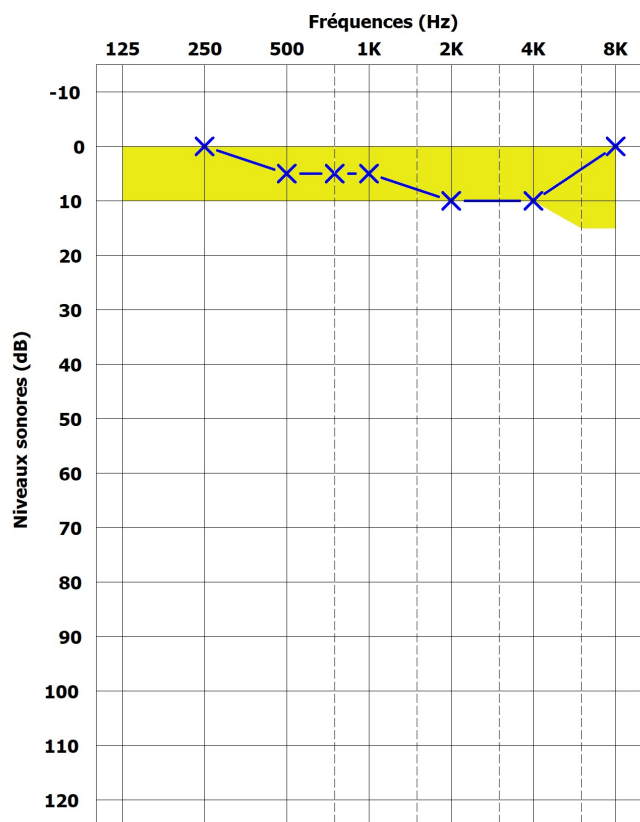

Oreille Gauche

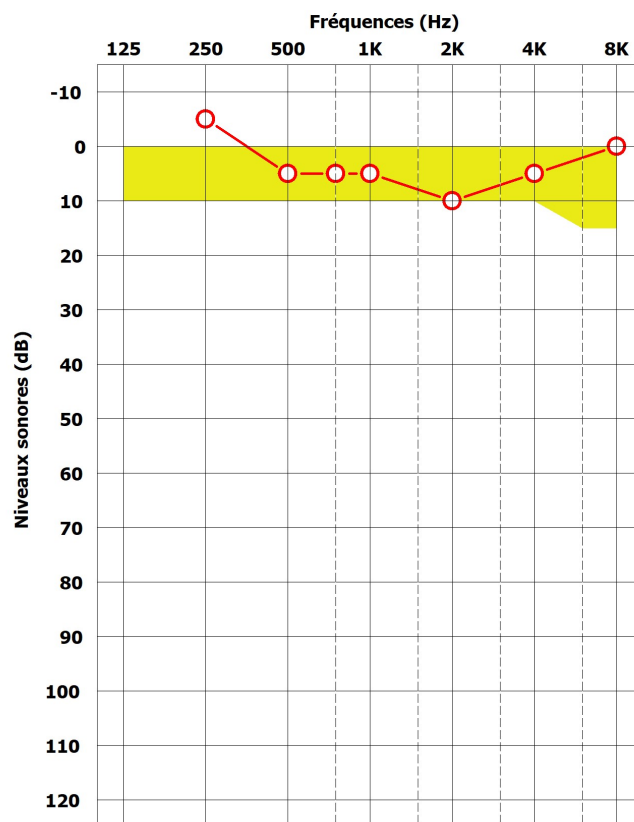

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 0   | 5   | 5   | 5  |     | 10 |    | 10 |    | 0  |
| CA Droit  |     | -5  | 5   | 5   | 5  |     | 10 |    | 5  |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 7,5 dB | --- |
| CA Droit        | 6,3 dB | --- |

Notes