


MED VIE


Date du test: 25/07/2024 13:07:07
Durée: 6mn 36s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CHEC
ID	24072512583491204

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

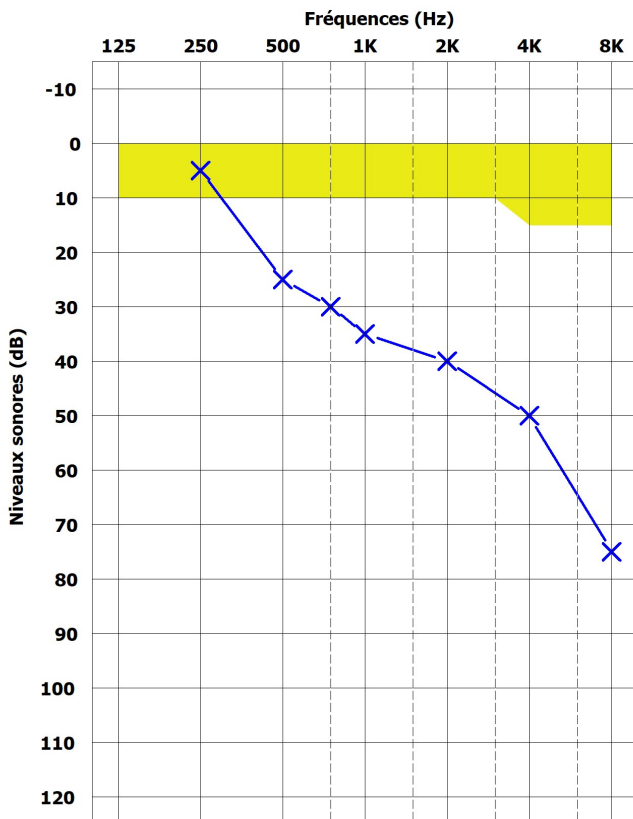

Oreille Gauche

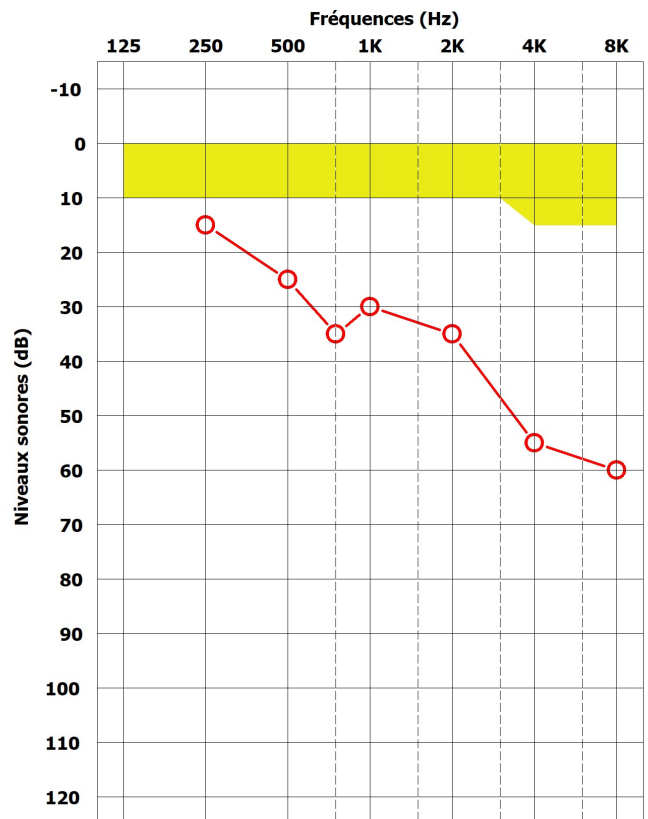

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	25	30	35		40		50		75
CA Droit		15	25	35	30		35		55		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	37,5 dB	---
CA Droit	36,3 dB	---

Notes