



Données Patient	
SYLLA SEYDOUBA	
Date de naissance	01/07/2001
Age	23
Société	CHEC
ID	24090613201641086

Date du test: 06/09/2024 13:22:11
Durée: 4mn 41s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

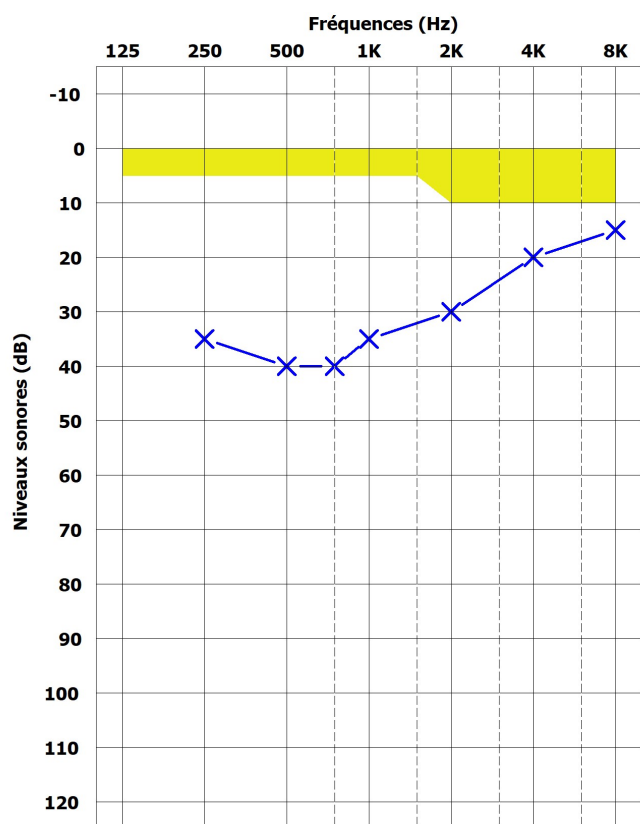

Oreille Gauche

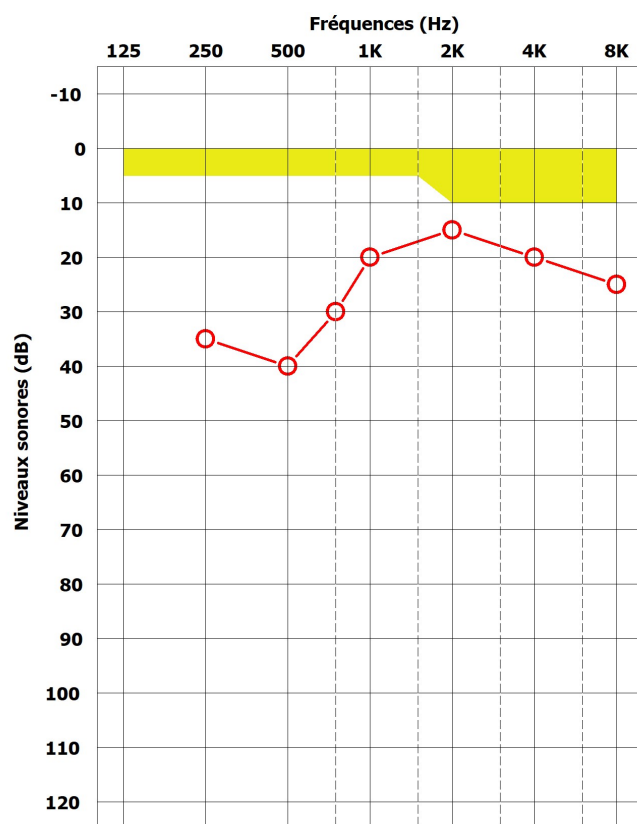

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	40	40	35		30		20		15
CA Droit		35	40	30	20		15		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes