



| Données Patient      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>DIALLO SALIOU</b> |                   |
| Date de naissance    | 14/12/1990        |
| Age                  | 33                |
| Société              | CHEC              |
| ID                   | 24070615030169996 |

Date du test: 06/07/2024 15:04:45  
Durée: 8mn 29s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

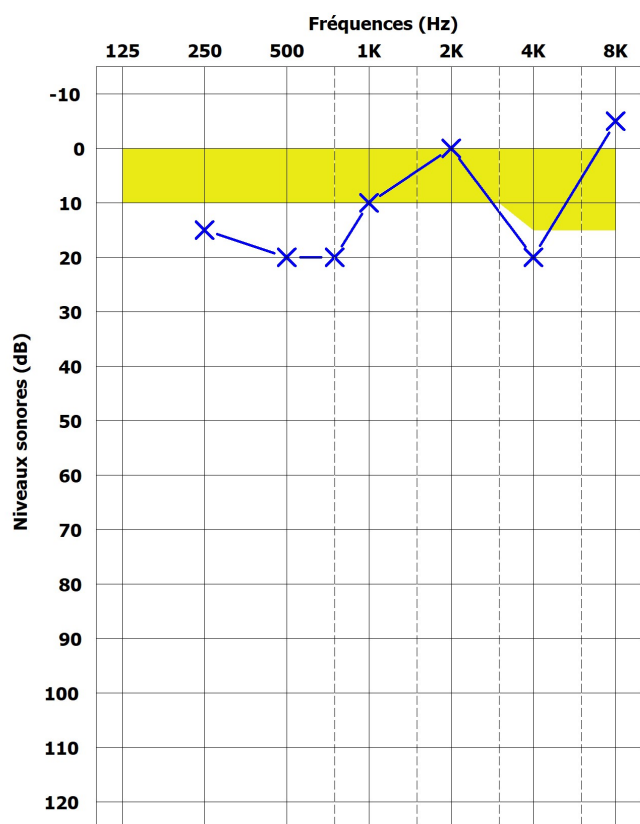

Oreille Gauche

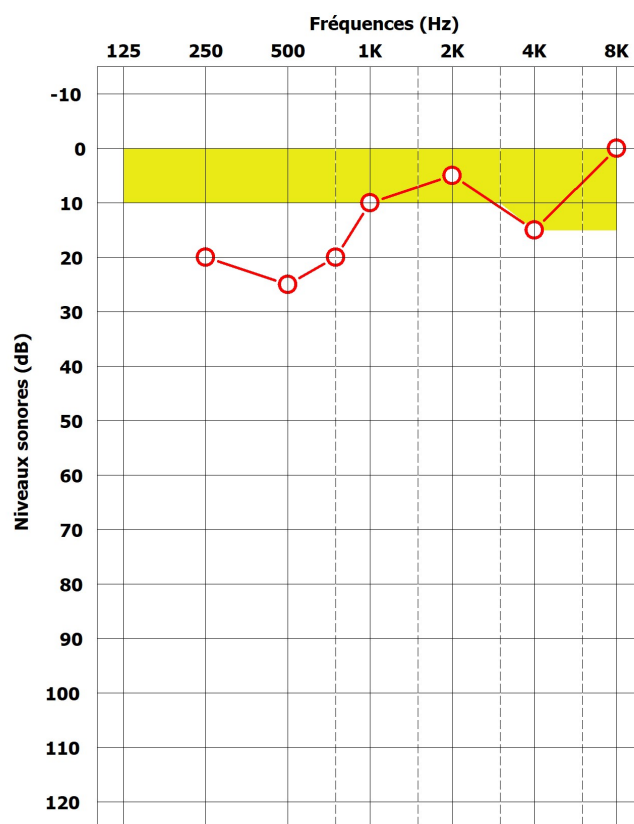

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 20  | 20  | 10 |     | 0  |    | 20 |    | -5 |
| CA Droit  |     | 20  | 25  | 20  | 10 |     | 5  |    | 15 |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 12,5 dB | --- |
| CA Droit        | 13,8 dB | --- |

Notes