


MEDVIE


Date du test: 07/09/2024 14:47:26
Durée: 5mn 02s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
Date de naissance	01/01/1980
Age	44
Société	CHEC
ID	24090714460385479

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

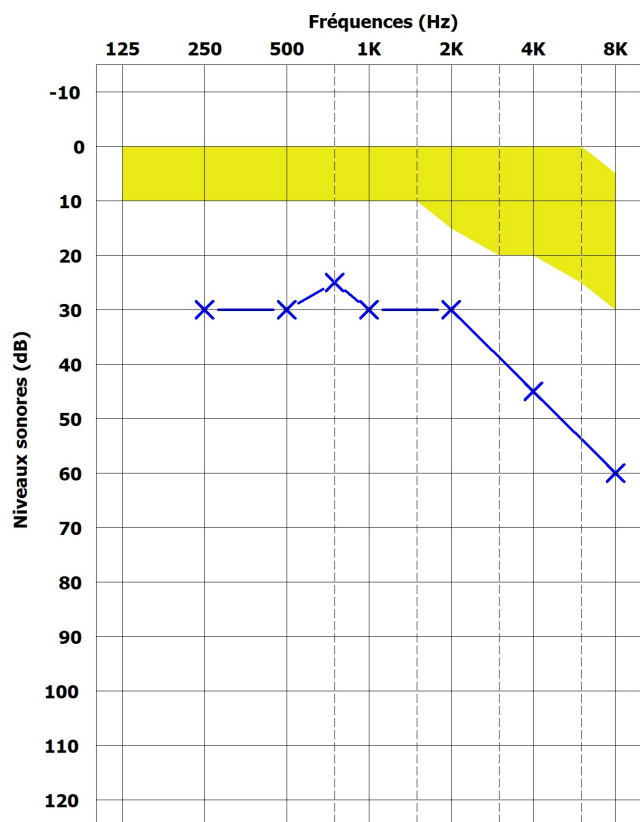

Oreille Gauche

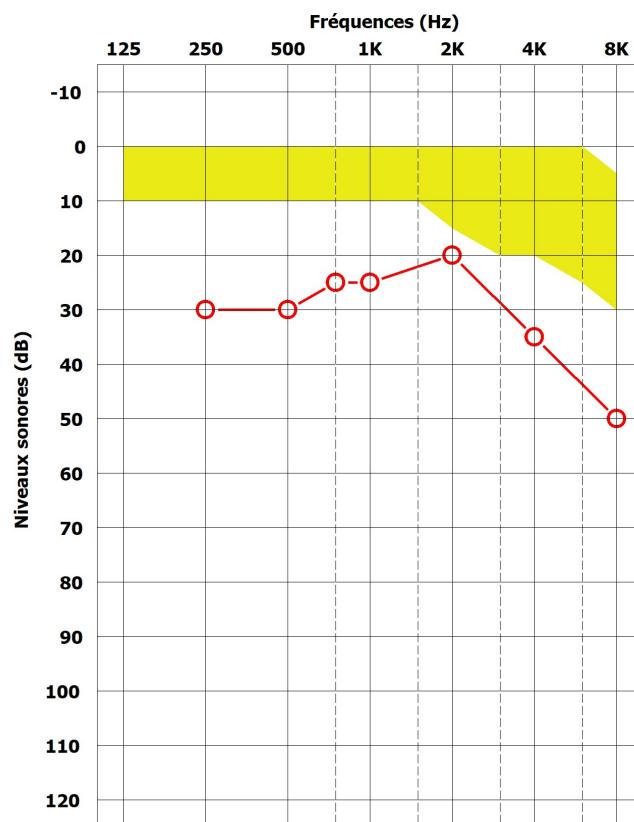

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	30		30		45		60
CA Droit		30	30	25	25		20		35		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	33,8 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes