



Données Patient	
SACKO MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1975
Age	49
Société	CHEC
ID	24091111303041253

Date du test: 11/09/2024 11:44:53
Durée: 4mn 42s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

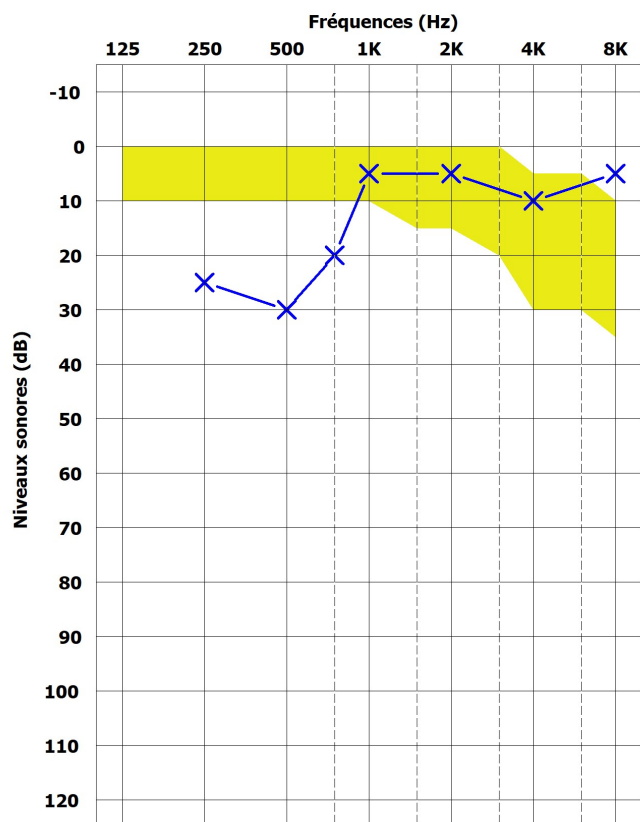

Oreille Gauche

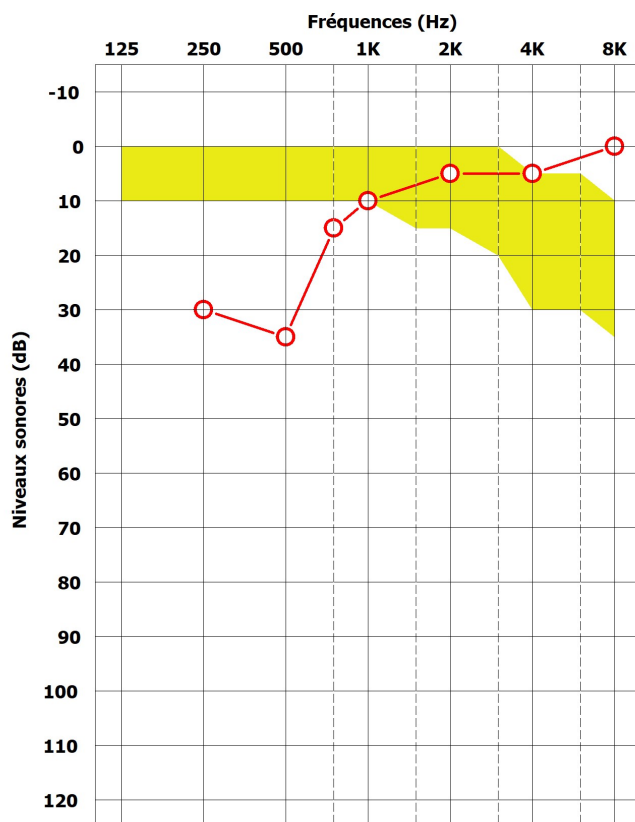

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	20	5		5		10		5
CA Droit		30	35	15	10		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes