


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 13:10:19
Durée: 4mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BANGOURA ABOUBACAR
Date de naissance	02/05/1995
Age	29
Société	CHEC
ID	24091413062713716

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

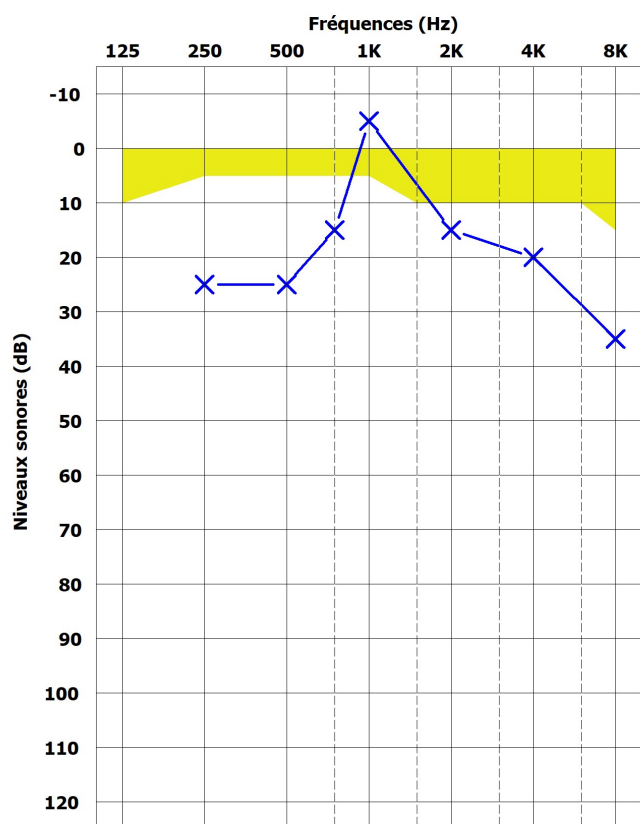

Oreille Gauche

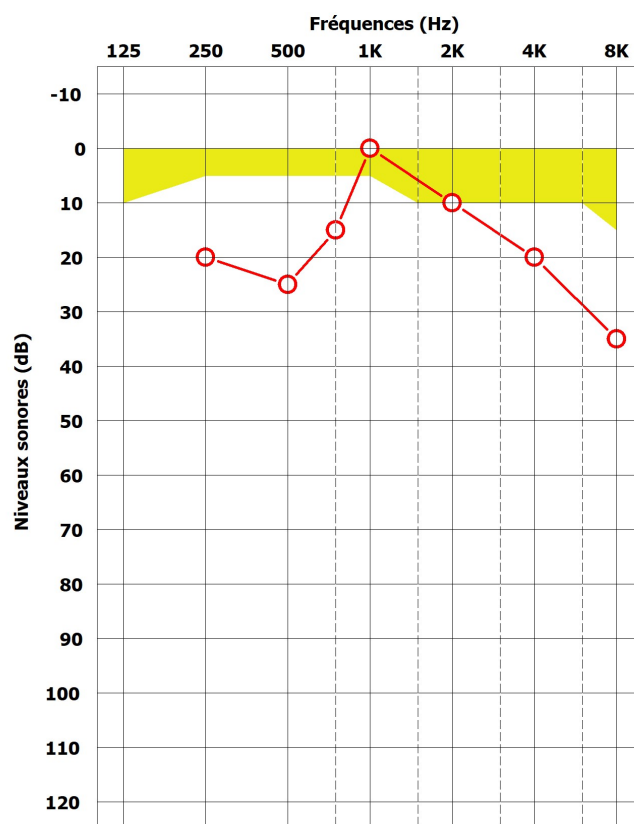

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	-5		15		20		35
CA Droit		20	25	15	0		10		20		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes