


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 13:00:13
Durée: 5mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO THIERNY AMADOU RORY	
Date de naissance	08/02/1992
Age	32
Société	CHEC
ID	24091412580717246

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

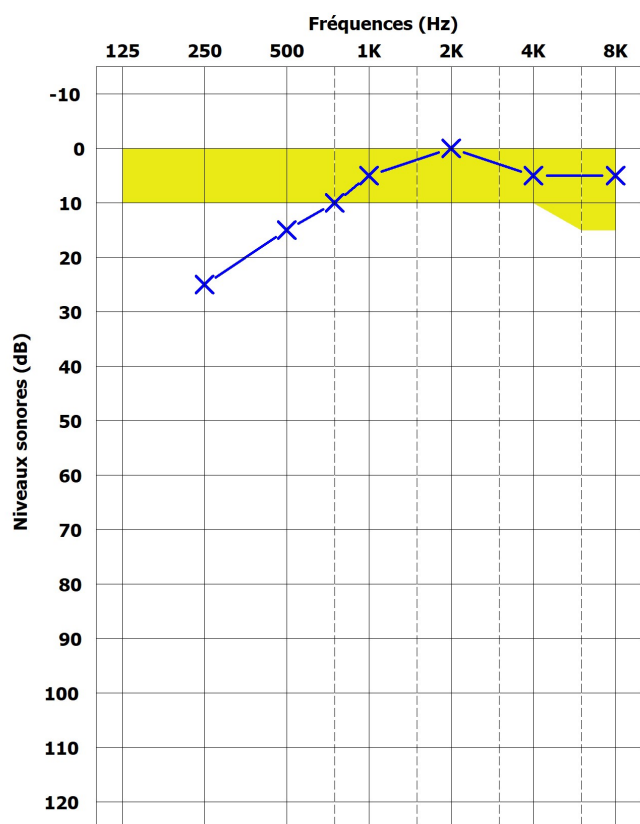

Oreille Gauche

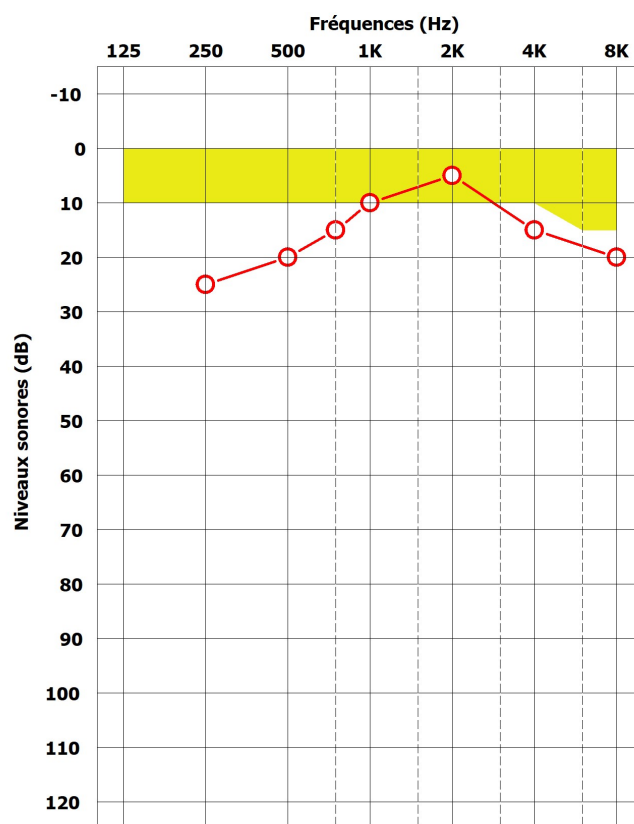

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	10	5		0		5		5
CA Droit		25	20	15	10		5		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes