

MED VIE

Date du test: 25/07/2024 11:42:44

Durée: 4mn 34s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **BANGOURA ABDOULAYE**

Date de naissance 01/01/1994

Age 30

Société CHEC


ID 24072511411660458

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

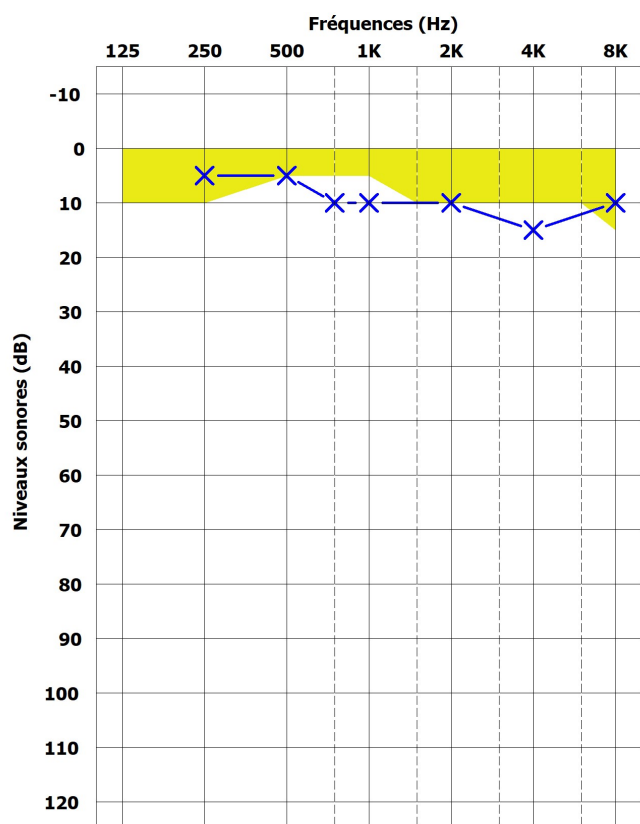

Oreille Gauche

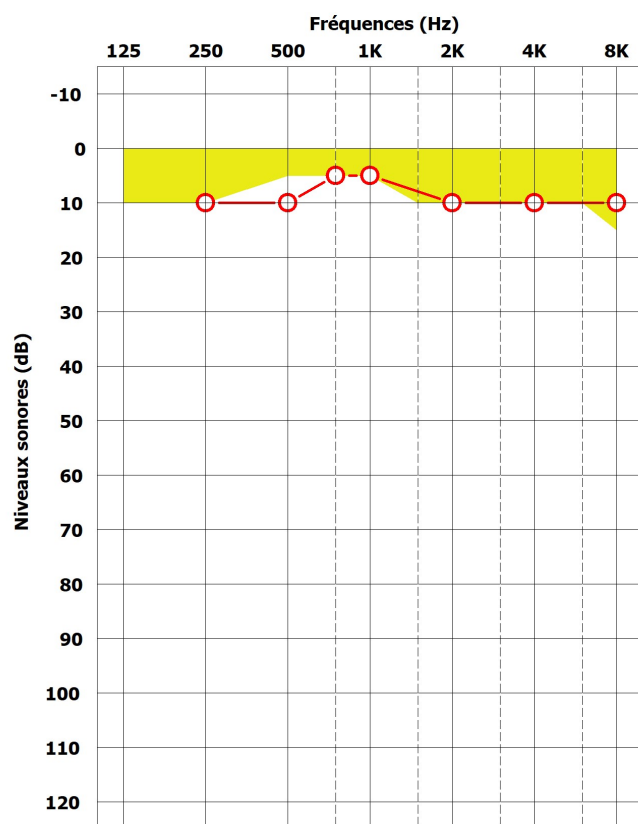

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	10	10		10		15		10
CA Droit		10	10	5	5		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes