

MED VIE


Date du test: 19/06/2024 15:15:07

Durée: 4mn 08s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | KEITA MOHAMED LAMINE |
|-------------------|----------------------|
| Date de naissance | 30/10/1995           |
| Age               | 28                   |
| Société           | CHEC                 |
| ID                | 24061915122320084    |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

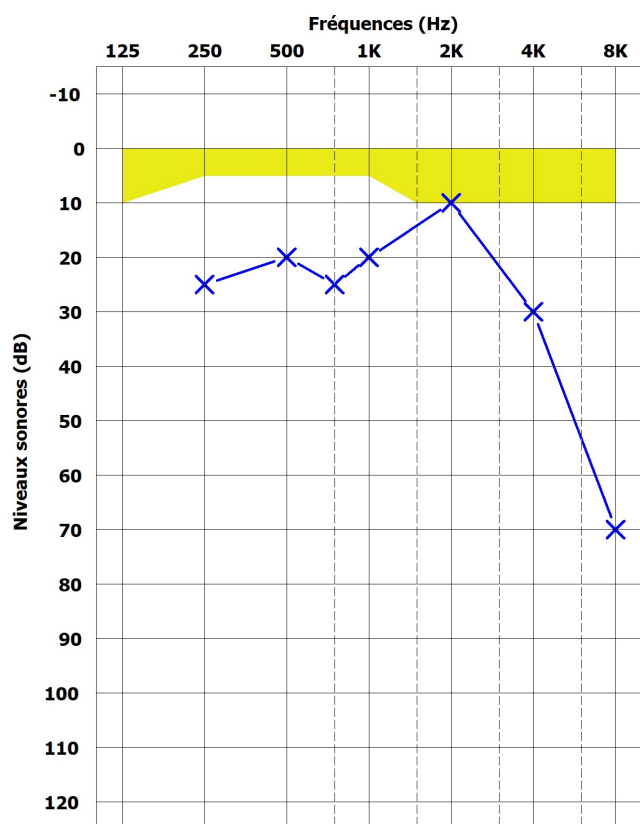

Oreille Gauche

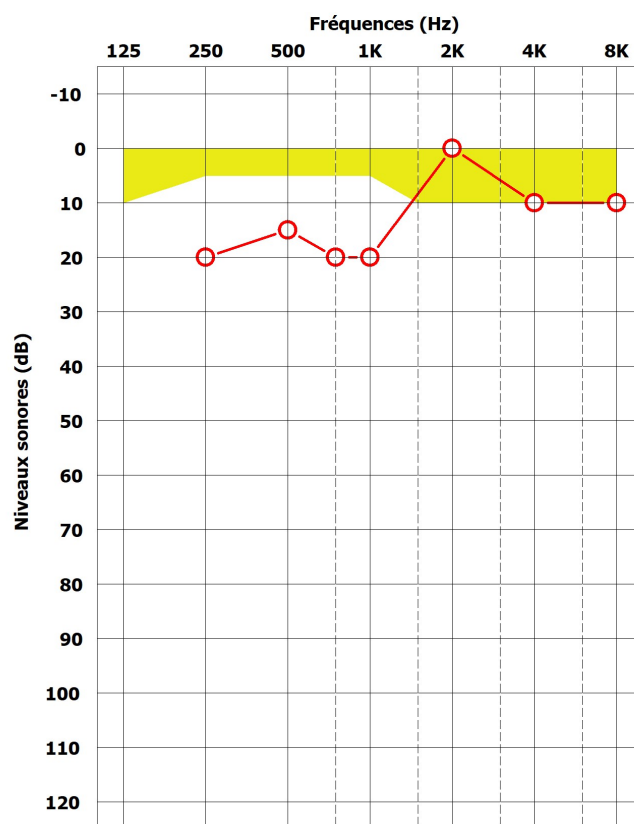

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 20  | 25  | 20 |     | 10 |    | 30 |    | 70 |
| CA Droit  |     | 20  | 15  | 20  | 20 |     | 0  |    | 10 |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 20,0 dB | --- |
| CA Droit        | 11,3 dB | --- |

Notes