

MED VIE


Date du test: 14/09/2024 13:23:26

Durée: 4mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		BAMBA SEINAN
Date de naissance	06/06/1989	
Age	35	
Société	CHRC	
ID	24091413164551674	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

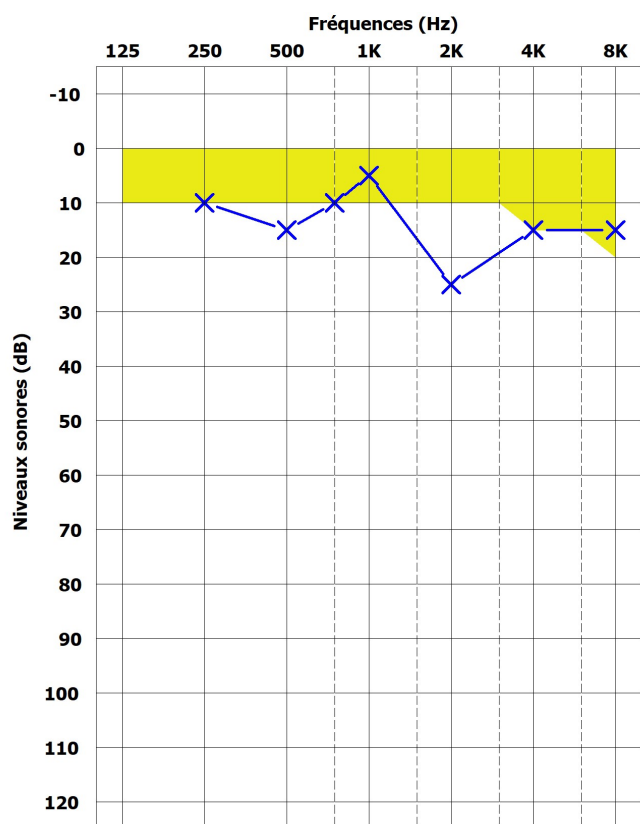

Oreille Gauche

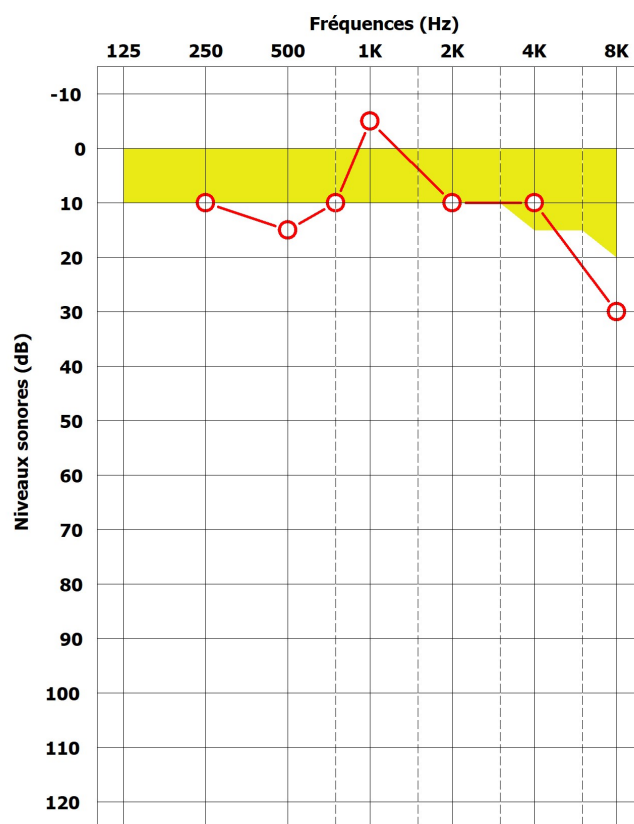

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	5		25		15		15
CA Droit		10	15	10	-5		10		10		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes