


MED VIE


Date du test: 25/07/2024 14:46:56
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	KEITA OUSMANE
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	CHEC
ID	24072514460491791

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

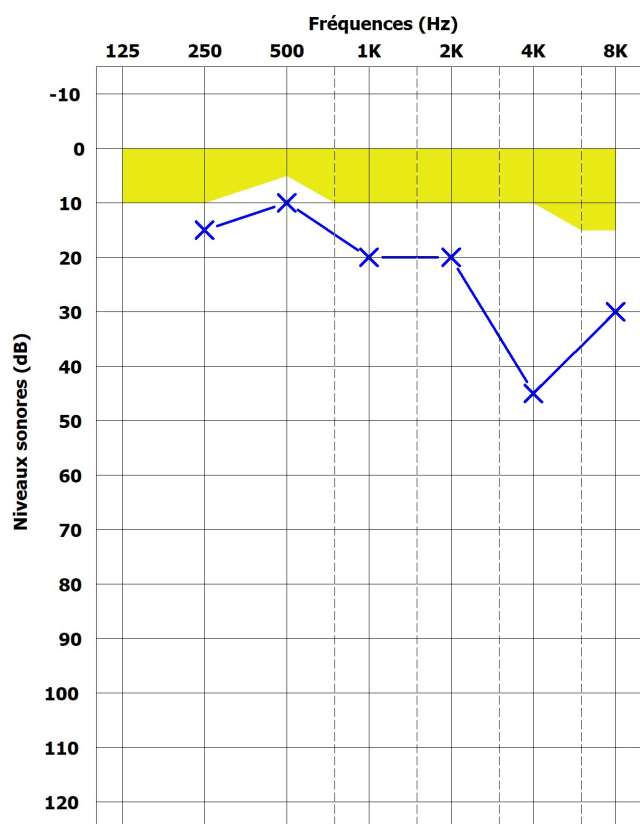

Oreille Gauche

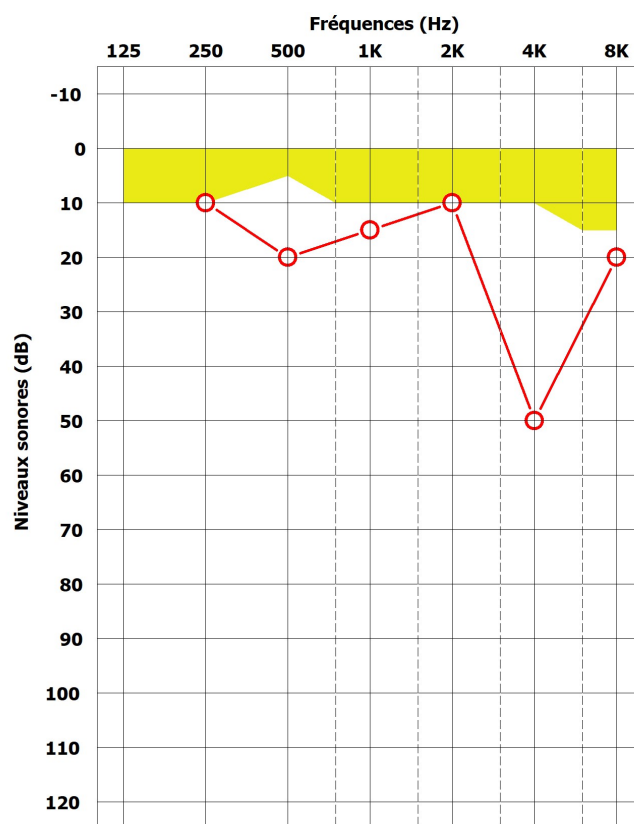

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10		20		20		45		30
CA Droit		10	20		15		10		50		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes