


MED VIE


Date du test: 25/07/2024 13:53:07
Durée: 4mn 52s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
BAMOUNGNE SOUII FYMANE	
Date de naissance	02/07/1984
Age	40
Société	CHEC
ID	24072513023828867

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

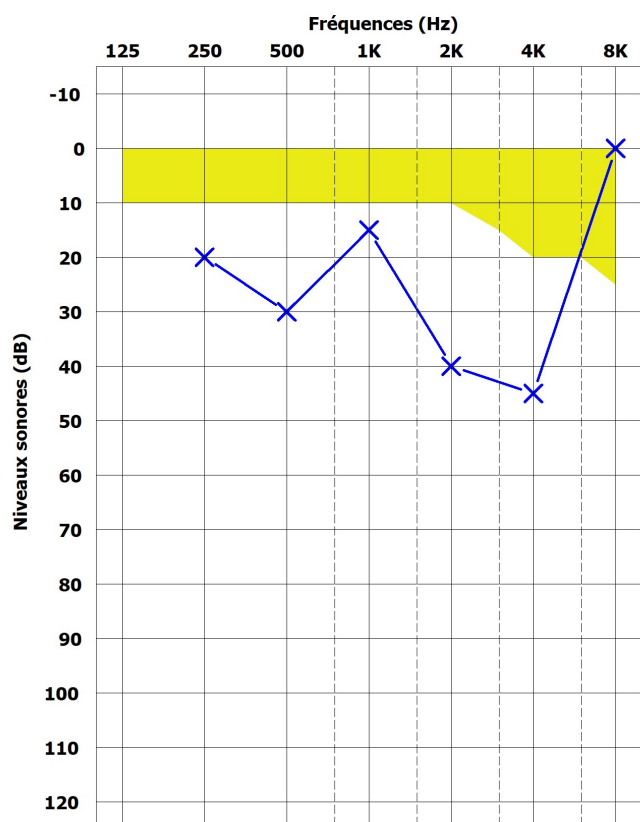

Oreille Gauche

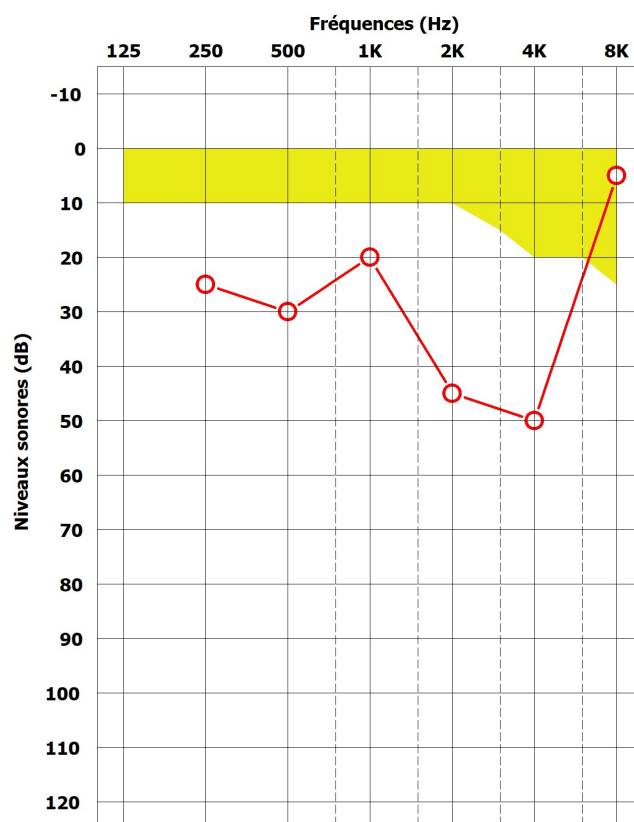

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	30		15		40		45		0
CA Droit		25	30		20		45		50		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	32,5 dB	---
CA Droit	36,3 dB	---

Notes