


MEDVIE


Date du test: 08/09/2024 12:40:22

Durée: 6mn 00s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

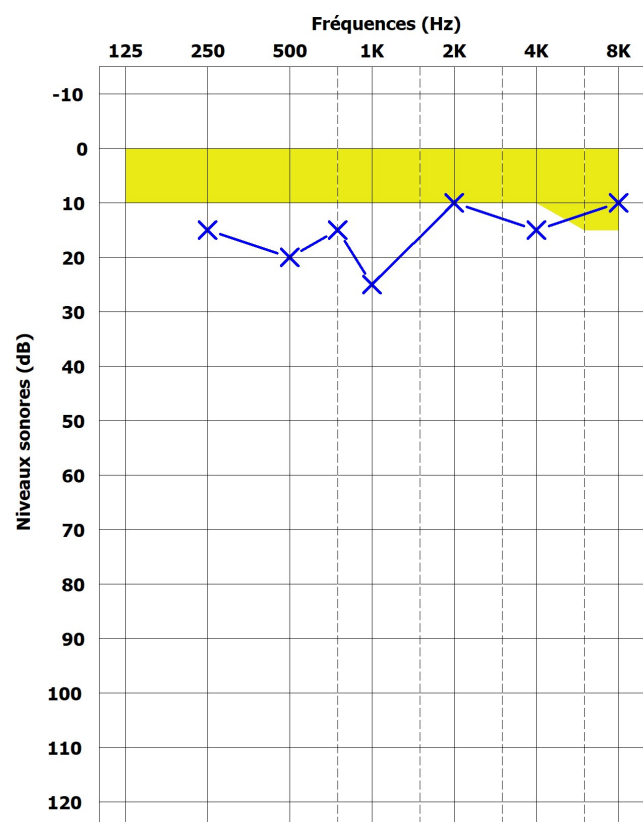

Oreille Gauche

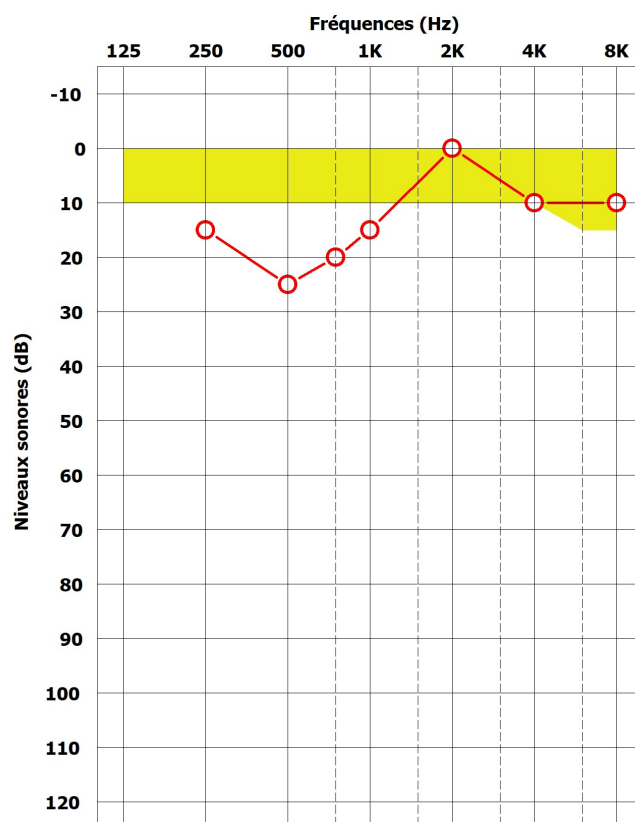

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	25		10		15		10
CA Droit		15	25	20	15		0		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient	BANGOURA IBRAHIMA SORRY
Date de naissance	01/07/1992
Age	32
Société	CHEC
ID	24090812384706953

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021