



Données Patient


DIABY SALIM

Date de naissance 01/01/1980
Age 44
Société CHEC
ID 24070515030002824


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 05/07/2024 15:04:28
Durée: 6mn 40s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

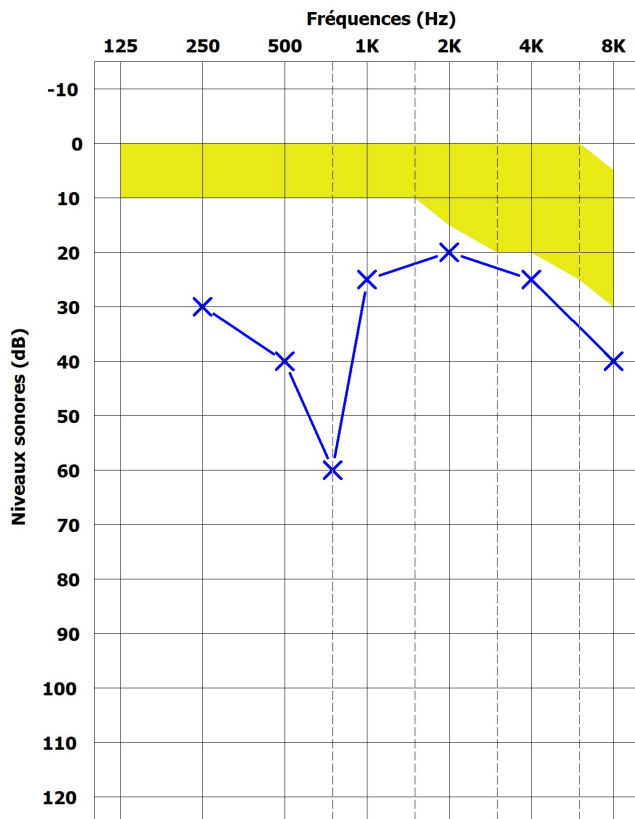

Oreille Gauche

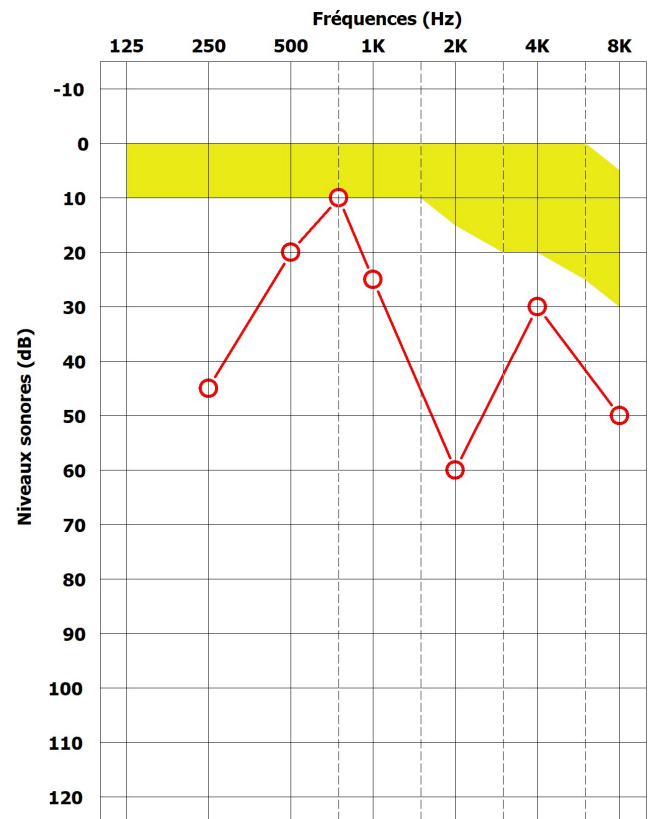

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	40	60	25		20		25		40
CA Droit		45	20	10	25		60		30		50

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	33,8 dB	---

Notes