



Données Patient

SOUHAN
ABDOULRAHMANE

Date de naissance

07/01/1996

Age

28

Société

CHEC

ID

24092514211080223

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211


Numéro de série:

2111EAT690093


Date Calibration :

30/11/2021

Date du test: 25/09/2024 14:24:33
Durée: 4mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

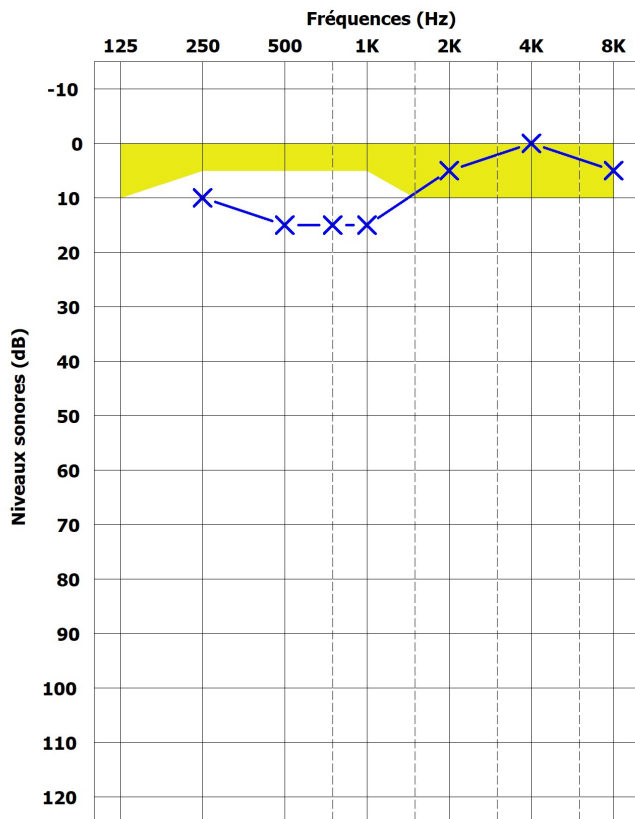

Oreille Gauche

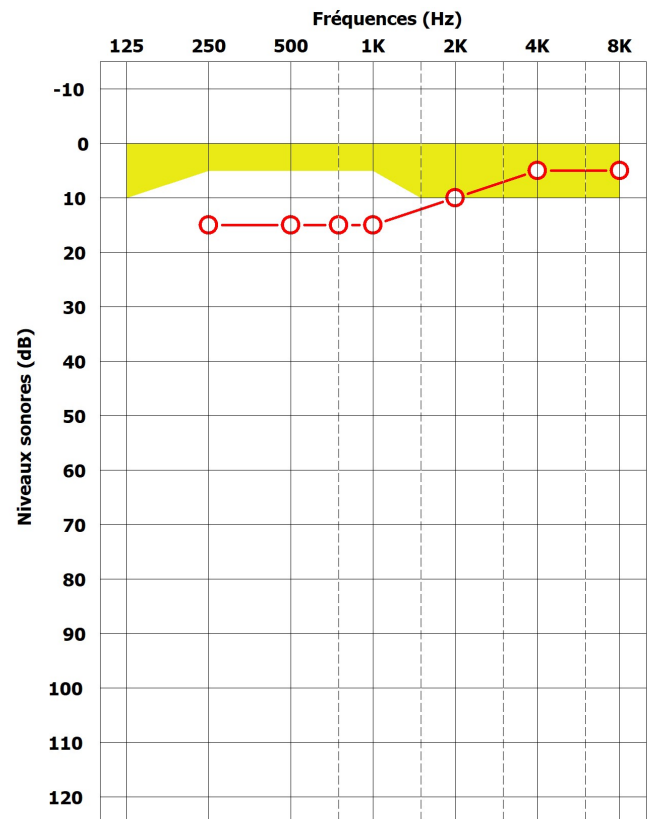

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	15		5		0		5
CA Droit		15	15	15	15		10		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes