

Données Patient

CAMARA SEKOU

Date de naissance

15/03/2002

Age

22

Société

CHEC

ID

24092518564330985

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :


30/11/2021

Date du test: 25/09/2024 18:58:01


Durée: 4mn 41s

Type test

Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

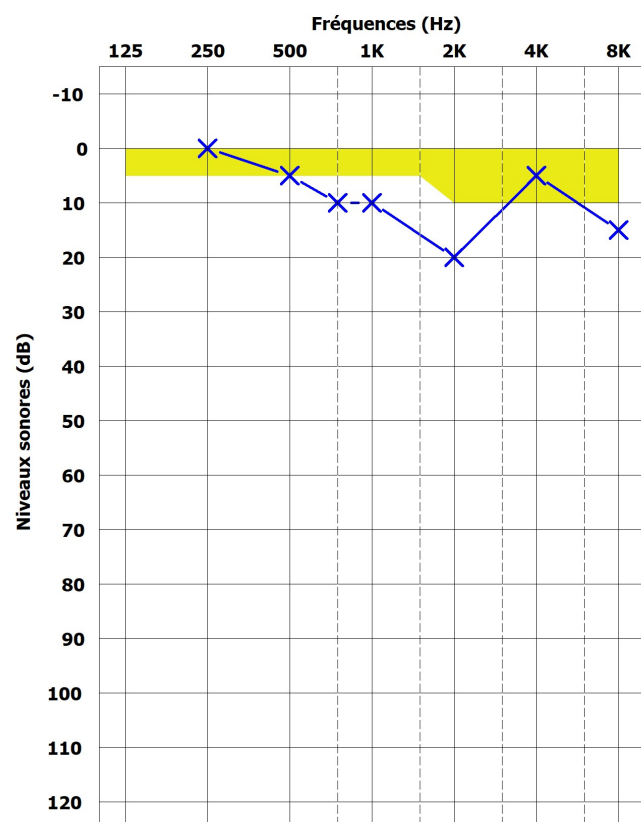

Oreille Gauche

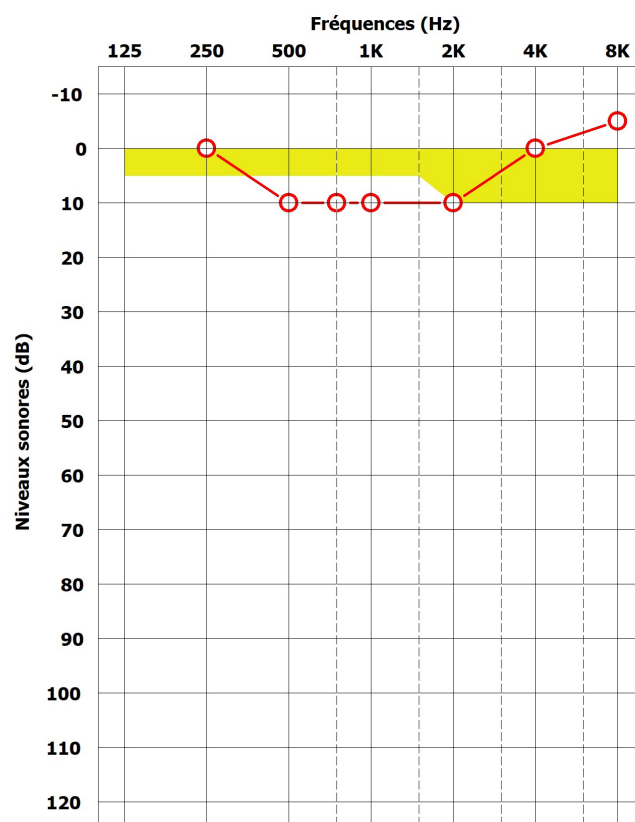

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	10	10		20		5		15
CA Droit		0	10	10	10		10		0		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes