



Données Patient


CAMARA OUSMANE

Date de naissance 01/01/1999
Age 25
Société CHEC
ID 24092517543775182


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 25/09/2024 17:56:14
Durée: 6mn 24s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

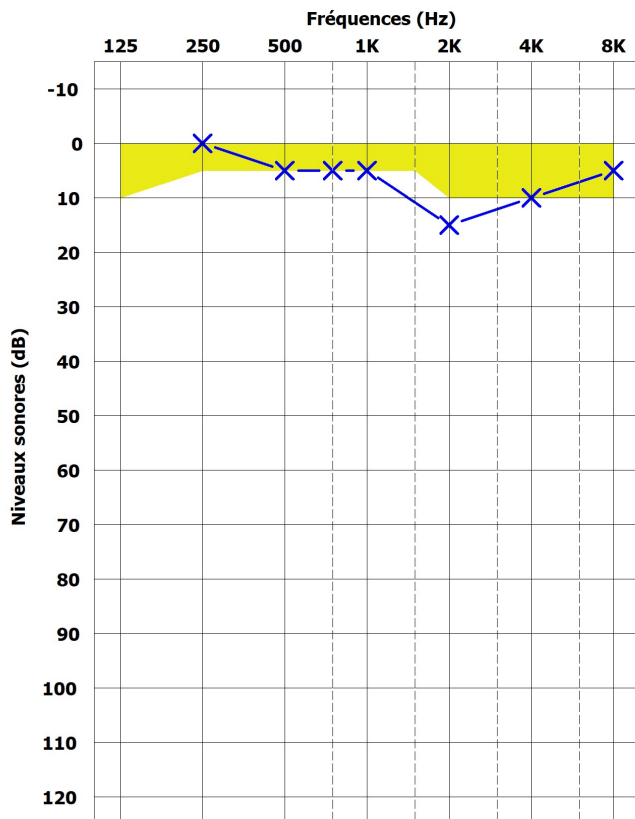

Oreille Gauche

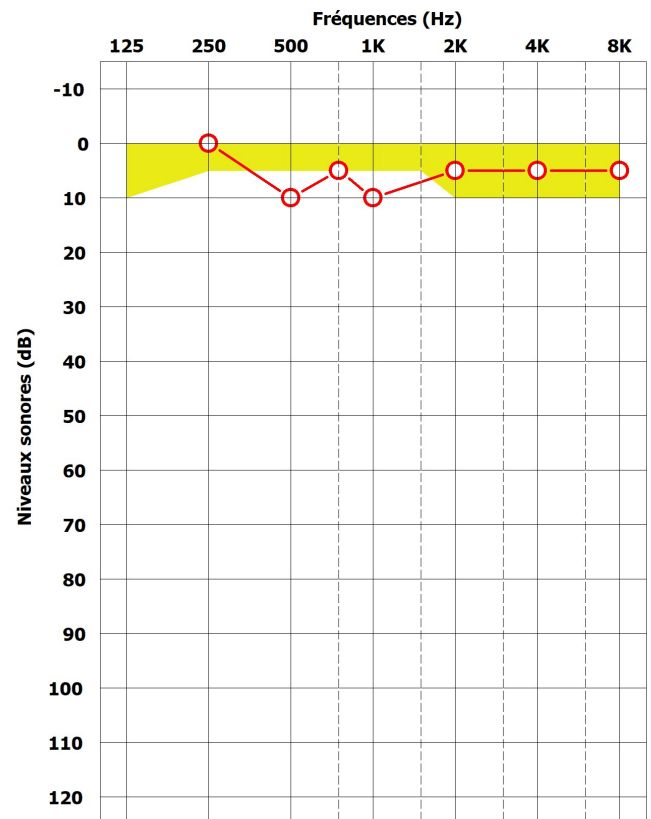

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	5	5		15		10		5
CA Droit		0	10	5	10		5		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes