



| Données Patient      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>KEITA MOHAMED</b> |                   |
| Date de naissance    | 01/04/1991        |
| Age                  | 33                |
| Société              | CHEC              |
| ID                   | 24070612212984354 |

Date du test: 06/07/2024 12:29:20  
Durée: 6mn 27s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

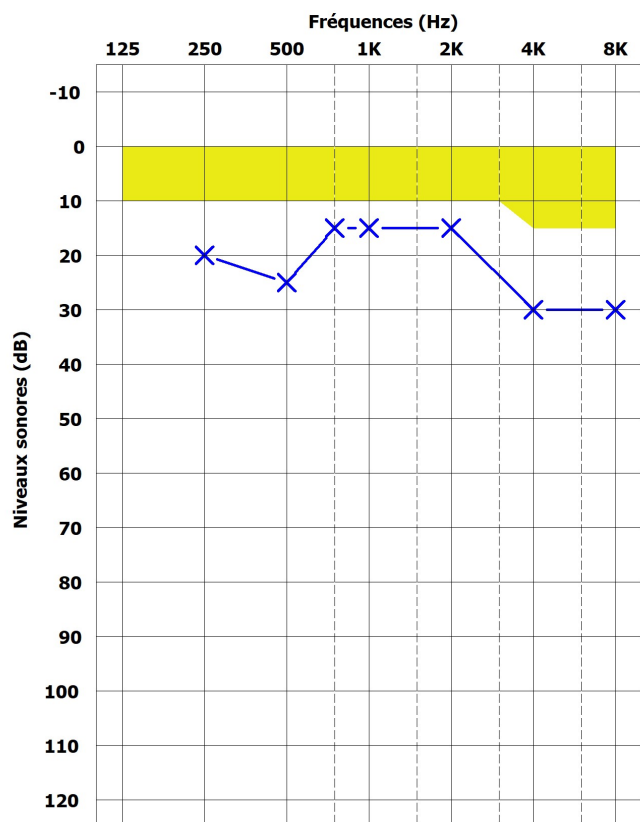

Oreille Gauche

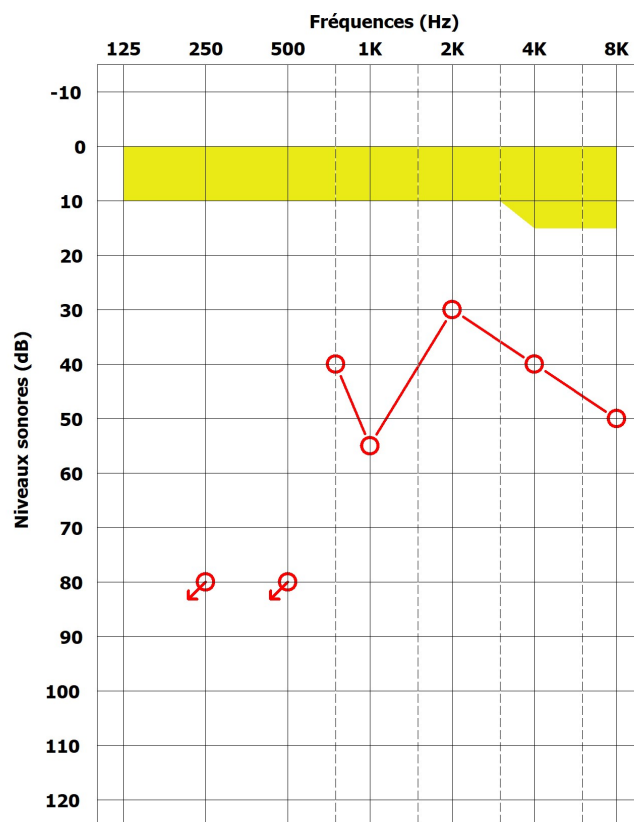

Oreille Droite

|           | 125 | 250  | 500  | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|------|------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 20   | 25   | 15  | 15 |     | 15 |    | 30 |    | 30 |
| CA Droit  |     | (80) | (80) | 40  | 55 |     | 30 |    | 40 |    | 50 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 21,3 dB | --- |
| CA Droit        | ---     | --- |

Notes