

MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 13:14:24

Durée: 3mn 50s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SYLLA SEMA
Date de naissance	12/01/1992
Age	32
Société	CHEC
ID	24071713113065381

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

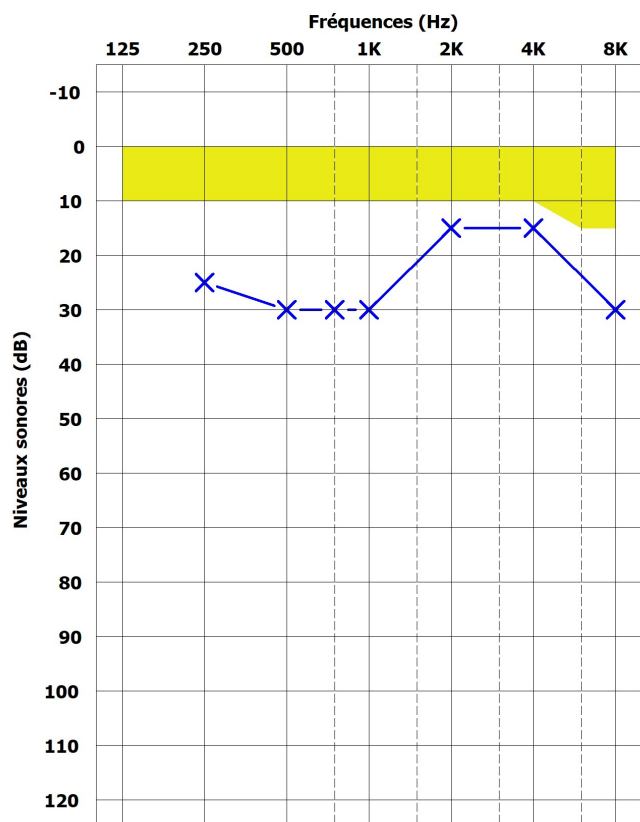

Oreille Gauche

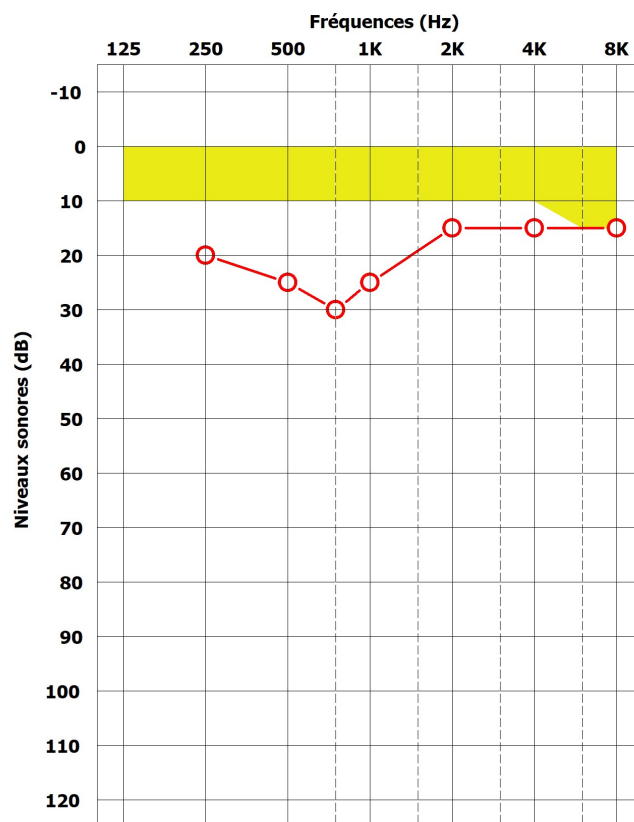

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	30	30		15		15		30
CA Droit		20	25	30	25		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes