

Données Patient


TOURE MOHAMED

Date de naissance 01/01/2001
Age 23
Société CHEC
ID 24092616391877274


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 26/09/2024 16:47:17
Durée: 4mn 54s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

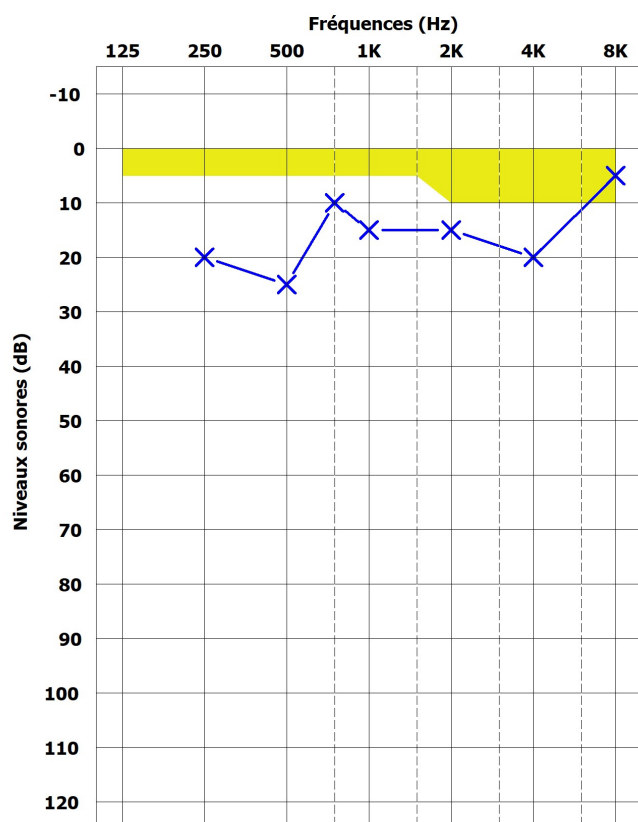

Oreille Gauche

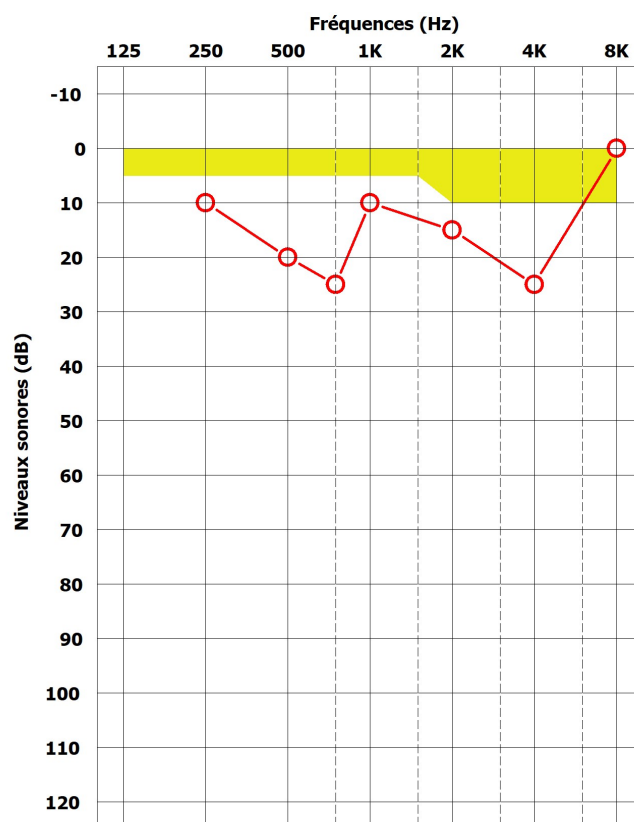

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	10	15		15		20		5
CA Droit		10	20	25	10		15		25		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes