


MEDVIE


Date du test: 09/08/2024 15:03:42
Durée: 3mn 39s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
CAMARA ABOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1979
Age	45
Société	CHEC
ID	24080915020499425

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

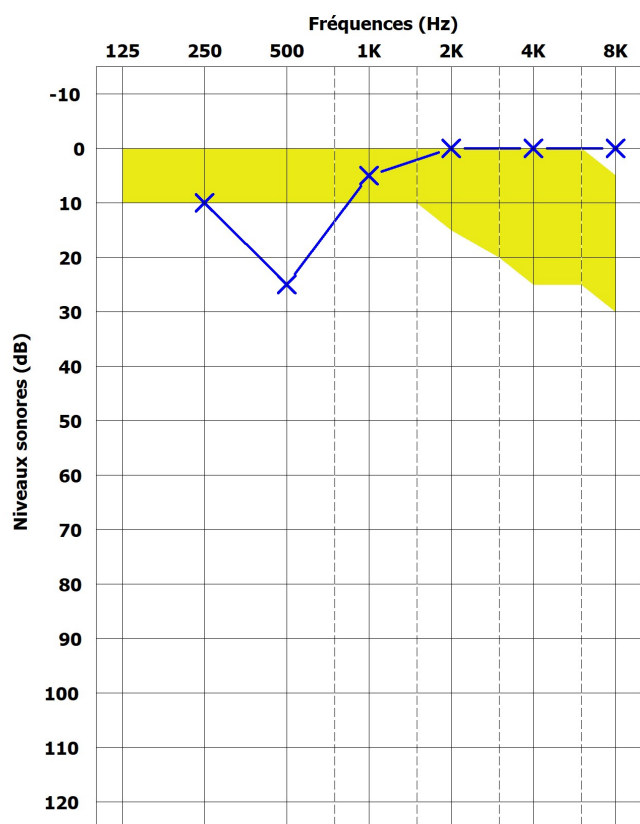

Oreille Gauche

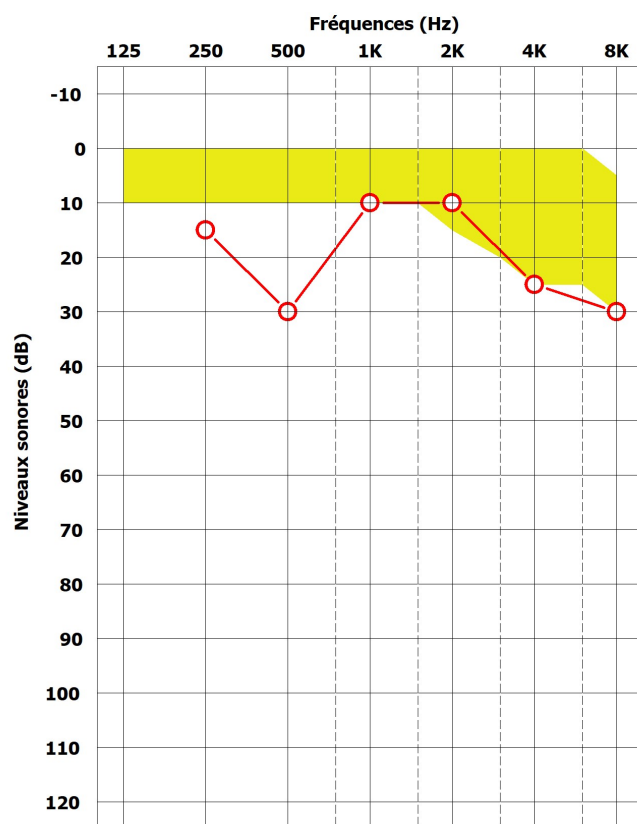

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25		5		0		0		0
CA Droit		15	30		10		10		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes