



Données Patient	DIALLO OUMAR BAILLO
Date de naissance	09/04/1985
Age	39
Société	CHEC
ID	24091112483659988

Date du test: 11/09/2024 13:23:39
 Durée: 5mn 07s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

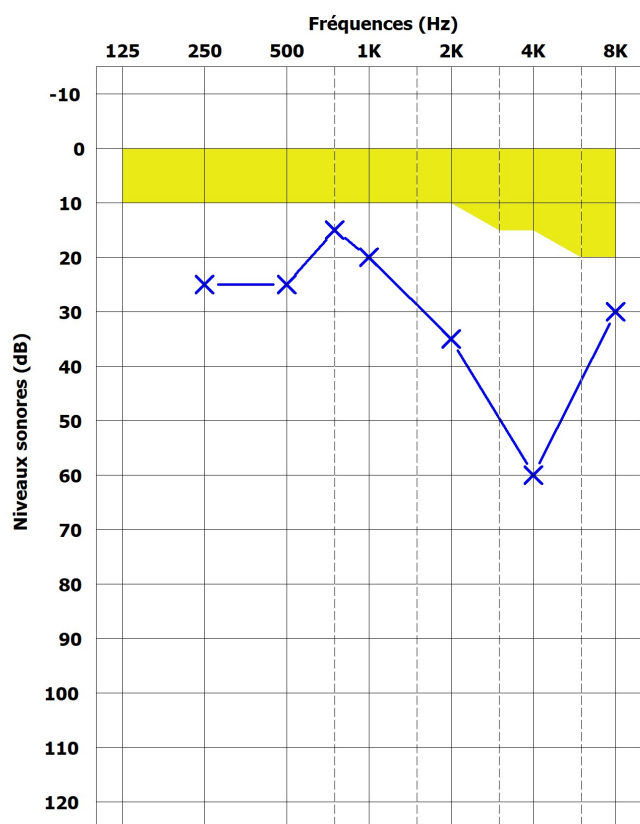

Oreille Gauche

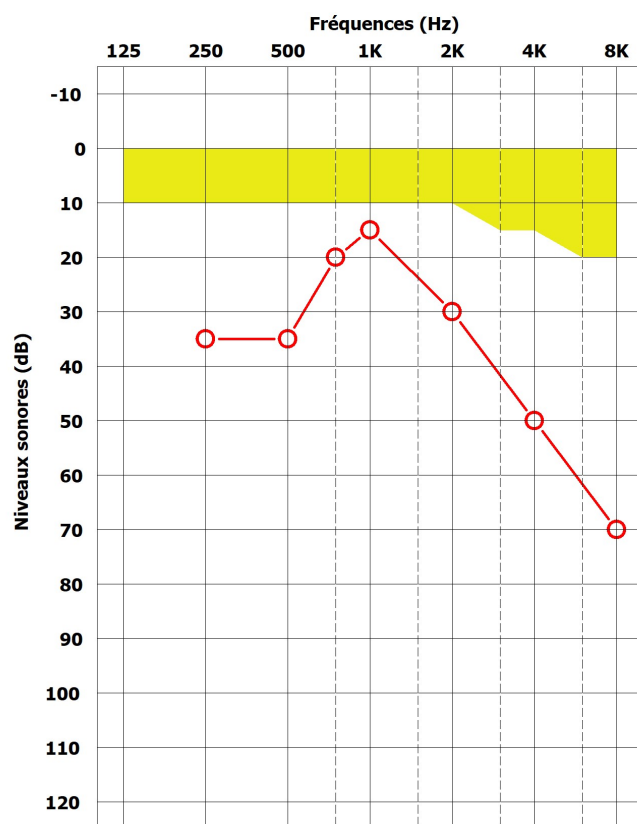

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	20		35		60		30
CA Droit		35	35	20	15		30		50		70

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	35,0 dB	---
CA Droit	32,5 dB	---

Notes