

MEDVIE

Date du test: 07/08/2024 11:18:24

Durée: 5mn 15s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

DIALLO FATOUMATA
RINTA

Date de naissance

03/03/2004

Age

20

Société

CHEC

ID

24080711131215856

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

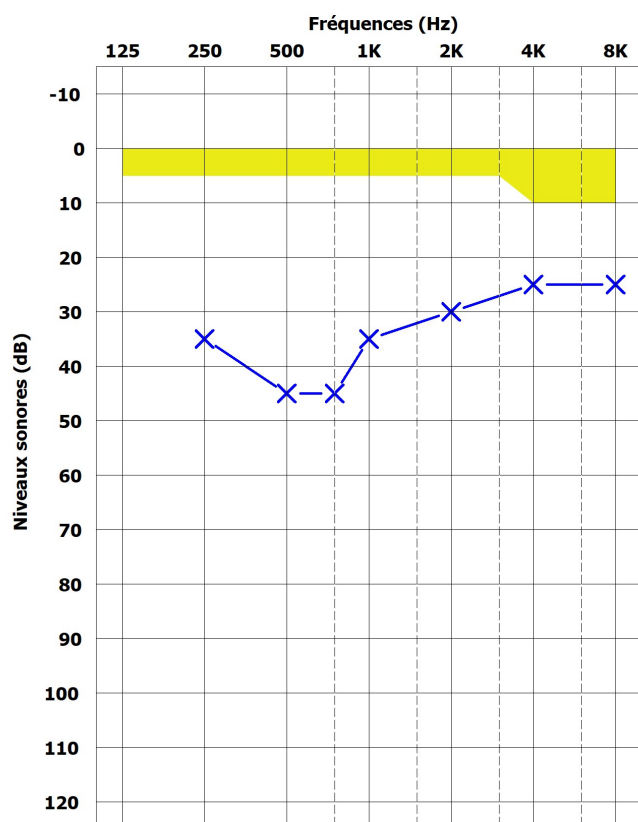

Oreille Gauche

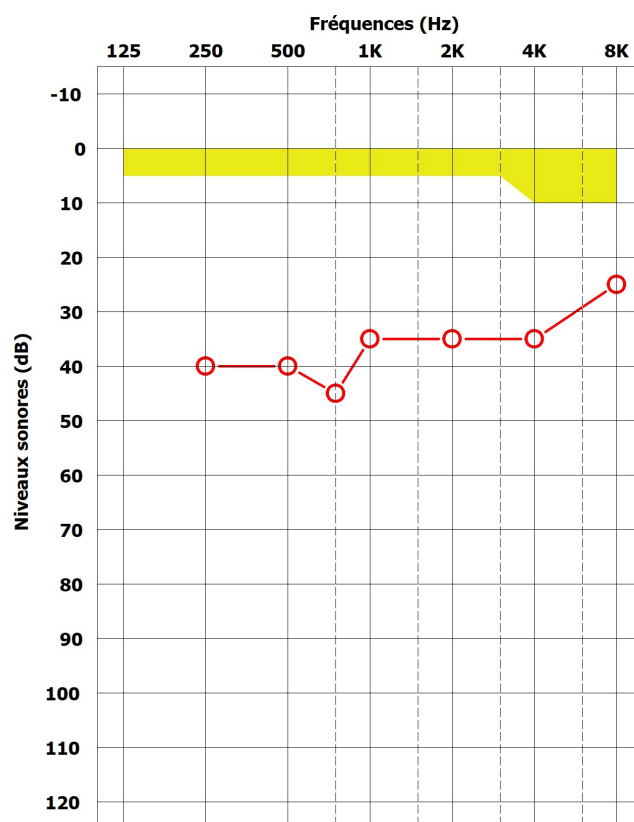

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	45	45	35		30		25		25
CA Droit		40	40	45	35		35		35		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	33,8 dB	---
CA Droit	36,3 dB	---

Notes